

Use Instructions for General Purpose Needle Guide

ULTRASOUND ACCESSORIES

POKYNY K POUŽITÍ
Jednorázový víceúčelový vodič jehly
ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BRUGERVEJLEDNING
Engangs nåleguide til generel brug
TILBEHØR TIL ULTRALYD

BEDIENUNGSANLEITUNG
universelle Einweg-Nadelführung
ULTRASCHALL-ZUBEHÖR

INSTRUCCIONES DE USO
Guía de aguja para uso general desechable
ACCESORIOS DE ULTRASONIDO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οδηγός βελόνας μίας γενικής χρήσης
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

MODE D'EMPLOI
Guide-aiguille universel jetable
ACCESSOIRES POUR ULTRASONS

ISTRUZIONI PER L' USO
Guida-ago multifunzione usa e getta
ACCESSORI A ULTRASUONI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
uniwersalna prowadnica igieł
jednorazowego użytku
AKCESORIA ULTRASONOGRAFICZNE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Útmutató az egyszer használatos általános
használatú tú alkalmazásához
AZ ULTRAHANG-KÉSZÜLKÉT TARTOZÉKAI

사용 지침
일반 용도의 니들 가이드용
초음파 검사용 부품

BRUKSANVISNING
Nåleddare för engångsbruk i allmänt syfte
TILLBEHÖR FÖR ULTRALJUD

使用方法
使い捨て汎用ニードルガイド
超音波検査用アクセサリ

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Guia da aguha para aplicação geral,
reutilizável
ACESSÓRIOS DE ECOGRAFIA

**ИНСТРУКЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**
одноразовый направляющий
канал для иглы общего назначения
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
УЛЬРАЗВУКОВЫХ СКАНЕРОВ

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Ghidaj de ac de unică folosință
pentru uz general
ACCESORII PENTRU ULTRASUNETE


KÄYTTÖOHJEET
kertakäytöinen yleiskäyttöinen
neulanohjain
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN LISÄVARUSTEET

GEBRUIKSINSTRUCTIES
Naaldgeleider voor algemene toepassing
(eenmalig gebruik)
ULTRASONE ACCESSOIRES

KULLANIM TALİMATLARI
Tek Kullanımlık Genel Amaçlı İğne Kılavuzu
ULTRASON AKSESUARLARI

使用说明
一次性通用针导子
超声附件



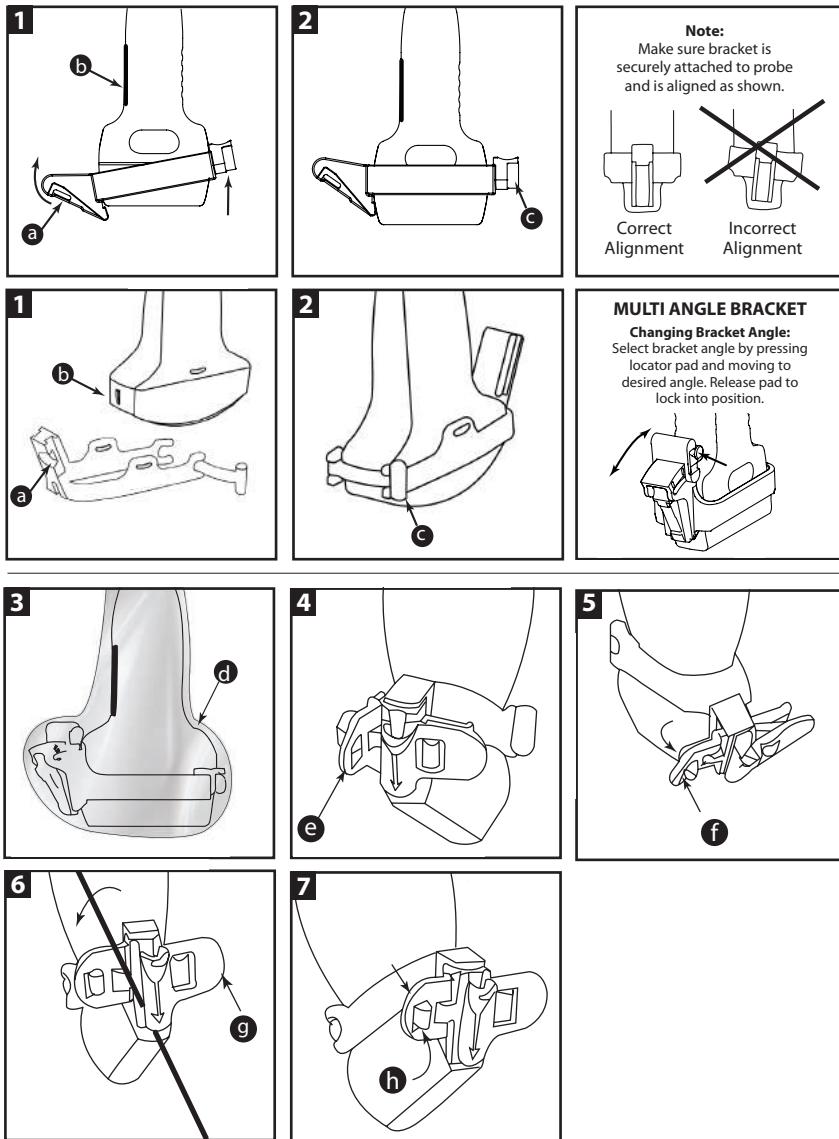

USE INSTRUCTIONS

Prepare probe per system's operational manual. Reusable bracket is provided non-sterile. Always verify needle follows guidelines prior to use.

⚠ If bracket/needle guide does not fit properly, do not use. Clean/sterilize bracket before use, following recommended instructions below. Use appropriate needle length to reach target area.

SINGLE ANGLE/MULTI ANGLE BIOPSY BRACKET (BRACKET IS REUSABLE)

- 1 Attach bracket (styles vary) to the probe, aligning needle guide receiver on the bracket (a) with the scanning side of the probe (b).
- 2 Make sure bracket is securely attached to probe (c).

DISPOSABLE GENERAL PURPOSE NEEDLE GUIDE

- 3 Place gel inside cover and/or on probe scanning surface. Place probe cover (d) over probe and bracket assembly. Secure cover with bands.
- 4 Place needle guide (e) onto mounting bracket over probe cover as shown with locking pad in elevated position.
- 5 Lock guide into position by pushing down locking pad and up on lock button (f) until completely closed.
- 6 For a quick release of the needle, press needle guide pad (g) and remove needle from guide.
- 7 After use, to remove needle guide, push up locking pad and down on lock button (h).

⚠ This needle guide is single-use only. **Do not reuse. Do not resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization of the single use devices may create a risk of cross contamination, patient infection, and / or malfunction of the device.**
After use, dispose of single-use components as infectious waste.
Do not use if sterile package is damaged.

STERILE EO

Do not re-use.

CLEANING, DISINFECTING & STERILIZING REUSABLE BRACKETS

Cleaning

Reusable devices must be thoroughly cleaned before they are subjected to the sterilization process. Remember, you cannot achieve sterilization or high-level disinfection unless the assembly is cleaned first.

1. Rinse excess soil from device.
2. Prepare the enzymatic solution (like Enzol), following manufacturer instructions for proper dilution.
3. Fully immerse the device in the detergent and allow soaking for 10 minutes.
4. After the soak, brush device thoroughly using a soft bristle brush. Clean lumens and holes using an appropriate size brush. A syringe might be used to flush the hard-to-reach areas of the device.
5. Thoroughly rinse and dry the device. Always use R/O (reverse osmosis) or DI (de-ionized) water for rinsing the device, tap water may recontaminate the reprocessed device. Use a clean soft cloth to dry the device.
6. Thoroughly examine all surfaces to make certain that no visible bioburden remains. If any visible parts observed on the device, repeat cleaning and drying, until the ENTIRE device is clean.

Recommendations for High Level Disinfection/Sterilization of Plastic or Anodized Aluminum Reusables

After cleaning by using the above recommendations, soak for a minimum of 5 minutes in a neutral pH Enzol Enzymatic detergent such as made by Johnson & Johnson®.

Sterilize with Cidex Activated Dialdehyde solution such as made by Johnson & Johnson®, or any equivalent validated sterilization method adopted by the sterilization department for like devices.

Steam Sterilization of Stainless Steel Reusables

After cleaning by using the above recommendations, steam sterilize (sterilizer type - gravity) in an autoclave at minimum 132 degrees Celsius (270 degrees Fahrenheit) for a minimum of 15 minutes. Dry the device for a minimum of 25 minutes. When sterilizing multiple instruments in one autoclave cycle, ensure that the sterilizer's maximum load is not exceeded.

Warning

- Long narrow cannulations and blind holes require particular attention during cleaning.
- Do not reuse or reprocess devices labeled for single-use.
- After sterilizing, appropriately package and store the device to ensure that sterility is not compromised prior to reuse.
- Always use a probe cover to minimize any contaminants.

Inspection and Function Testing

- Visually inspect for damage and wear. For hinged instruments, check for smooth movement of hinge without excessive "play." Locking mechanisms should be checked for action.

Limitations on Reprocessing











Repeated processing has minimal effect on these devices. End of life is normally determined by wear and damage due to use.

For translations of this instruction, go to www.protekmedical.com.

For more information contact Protek Medical Products, Inc.

Disclaimer:

The instructions provided above have been validated by the medical device manufacturer as being capable of preparing a medical device for re-use. It is the user's responsibility to qualify any deviations from recommended method of processing, and properly evaluate for effectiveness and potential adverse consequences.

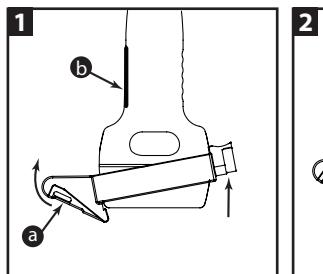

POKYNY K POUŽITÍ

Připravte sondu podle Příručky uživatele systému. Opakovaně použitelný držák je dodáván nesterilní. Poznámka: Při používání pokynů systému, vždy se před použitím ubezpečte, že jehla odpovídá témtoto pokynům!

⚠️ Pokud držák nebo vodič jehly nesedí správně, nepoužívejte je. Před prvním použitím držák vyčistěte a vysterilizujte podle doporučených pokynů uvedených níže. Používejte odpovídající délku jehly, abyste dosáhli cílové oblasti.

Jednoúhlový držák/Víceúhlový držák bioptické jehly (Držák je opakovaně použitelný)

- 1 Držák připevněte (způsoby se liší) k sondě tak, aby přijímač jehly na držáku (a) seděl se snímací stranou sondy (b).
- 2 Ujistěte se, že je držák bezpečně připojen k sondě (c).

Jednorázový víceúčelový vodič jehly

- 3 Naneste gel na vnitřní stranu obalu a/nebo na snímací plochu sondy. Navlékněte obal sondy (d) přes smontovanou sondu s držákem. Připevněte obal pásky.
- 4 Připevněte vodič jehly (e) k držáku, jak je patrné na obrázku, s aretační podložkou ve vyvýšené poloze.
- 5 Upevněte vodič jehly do správné polohy přitisknutím na aretační podložku a zvednutím aretačního tlačítka (f).
- 6 K rychlému uvolnění jehly, stiskněte podložku vodiče jehly (g).
- 7 K odstranění vodiče jehly vytáhněte aretační podložku nahoru a stiskněte aretační tlačítko dolů (h).

⚠️ Vodič jehly je pouze k jednorázovému použití. **Nepoužívejte opakováně. Nesterilizujte opakováně. Opakováně použití, zpracování či sterilizace zařízení mohou vest k riziku klíčové kontaminace, infekce pacienta a/nebo nesprávné funkci zařízení.** Jednorázové komponenty po použití zlikvidujte jako infekční odpad. Nepoužívejte, pokud je sterilní obal poškozený.

STERILE EO

✖️ Nepoužívejte opakováně.

Čištění, dezinfekce a sterilizace znova použitelných zařízení

Čištění

Opakováně používané příslušenství musí být důkladně vyčištěno dříve než bude vystaveno sterilizačnímu procesu. Pamatujte si, nebudete schopni sterilizovat nebo dosáhnout vysoké úrovni dezinfekce pokud není příslušenství nejdříve vyčištěno.

1. Ze zařízení vypláchněte nadbytečné nečistoty.
2. Připravte enzymatický roztok (např. enzol), správného ředění dosáhněte dodržením pokynů výrobce.
3. Zařízení zcela ponorte do čisticího prostředku a ponechte jej namočené po dobu 10 minut.
4. Poté jej pomocí měkkého kartáče důkladně vyčistějte. Jednotlivé průchody a otvory vyčistěte kartáčem o odpovídající velikosti. Těžko přístupná místa lze vypláchnout stříkátkou.
5. Zařízení důkladně opláchněte a vysušte. K vyplachování zařízení používejte vždy R/O (reverzní osmóza) nebo DI (deionizovaná) vodu, voda z vodovodu může opětovně znečistit vyčištěné zařízení. K vysušení používejte čistou měkkou utěrkou.
6. Důkladně zkонтrolujte všechny plochy, abyste se ujistili, že na zařízení nazůstaly viditelné prvky biologické zátěže. Pokud jste na zařízení naznamenali jakékoli viditelné prvky, opakujte čištění a sušení, dokud zařízení nebude ZCELA čisté.

Doporučení pro dezinfekci a sterilizaci plastů nebo anodizovaných hliníkových znova použitelných zařízení

Po čištění za použití výše uvedených pokynů, Namočte na minimálně 5 minut do enzymatického prostředku s neutrálním pH jako je například Enzol vyroběný společností Johnson & Johnson®.

Sterilizujte pomocí roztoku dialdehydu aktivovaného přípravkem Cidex, který vyrábí například společnost Johnson & Johnson, případně jakoukoliv ekvivalentní sterilizační metodou jednohrazenou sterilizačním oddělením pro tato zařízení.

Sterilizace parou znova použitelných zařízení z nerezové oceli

Po čištění podle výše uvedených doporučení proveďte sterilizaci parou (typ sterilizátoru – gravitační) v autoklávu při minimálně 132 stupních Celsius (270 stupňů Fahrenheita) po dobu alespoň 15 minut. Zařízení vysušujte alespoň 25 minut. Při sterilizaci několika nástrojů v jednom autoklávním cyklu dbejte na to, aby nebylo překročeno maximální zatížení sterilizátoru.

Varování

- Dlouhé úzké kanyly a slepé otvory vyžadují v průběhu čištění zvláštní pozornost.
- Znovu nepoužívejte a nezpracovávejte zařízení označené jako určená na jednorázové použití.
- Po sterilizaci náležitě zabalte a skladujte zařízení tak, aby ste zabezpečili, že bude zachována sterilizace do dalšího použití.
- Vždy používejte obal na sondu, abyste minimalizovali kontaminaci.

Kontrola a testování funkcí

Vizuálně zkontrolujte poškození a opotřebení. U kloubových nástrojů zkontrolujte plynulost pohybu bez nadmerné „výlohy“. Je třeba zkontrolovat funkčnost zavíracího mechanismu.

Omezení při obnově


Opakováně postup obnovy má minimální dopady na tato zařízení. Životnost zařízení závisí na opotřebení a poškození v průběhu používání.

Pro překlad této pokyny navštivte www.protekmedical.com.

Více informací Vám poskytne společnost Protek Medical Products, Inc.

Zřeknutí se práv:

Pokyny uvedené výše byly schváleny výrobcem lékařského zařízení a mely by umožnit připravit lékařské zařízení k opětovnému použití. Uživatel nese odpovědnost za jakékoli odklonění od doporučeného postupu, jakož i za správné vyhodnocení účinnosti a možné neprávní následky.

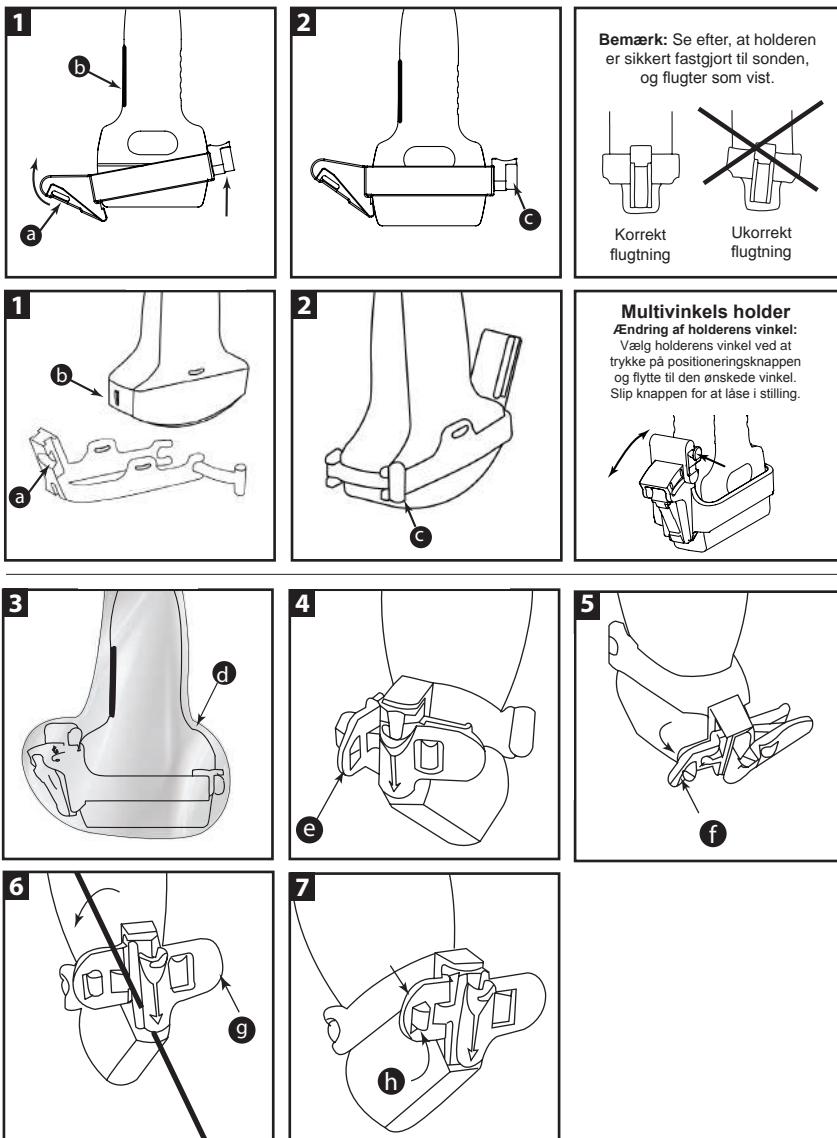**BRUGERVEJLEDNING**

Forbered sonden ifølge systemets betjeningsvejledning. Genbrugelig holder leveres ikke-steril.
Bemærk: Når systemretningslinier bruges, kontrollér altid at nålen følger retningslinien før brug!

! Hvis holder/nåleguide ikke passer rigtigt, så brug dem ikke. Rengør/steriliser holderen iht. anbefalingerne nedenfor. Brug passende nålelængde til at nå målområdet.

Enkeltvinkels/Multivinkels biopsi-holder (Holderen er genbrugelig)

- 1 Fastgør holderen (typen kan variere) til sonden, og indstil nåleguide-modtageren på holderen (a) ved hjælp af sondens scanningsside (b).
- 2 Vær sikker på at klammen sidder helt fast på sonden (c).

Engangs nåleguide til generel brug

- 3 Placer gel indeni omslaget og / eller på sondescanningsoverfladen. Placer sondeomslaget (d) over sonde- og klammesamlingen. Fastgør omslaget med båndene.
- 4 Placer nåleguiden (e) på klammen som vist med låsemekanismen i hævet position.
- 5 Lås nåleguiden på plads ved at trykke ned på låsemekanismen og skubbe op på låseknappen (f).
- 6 For hurtig udløsning af nålen, tryk på nåleguidemekanismen (g).
- 7 For at fjerne nåleguiden, træk op i låsemekanismen og tryk ned på låseknappen (h).

! Nåleguiden er kun til engangsbrug. **Må ikke genbruges. Må ikke gensteriliseres.** Genbrug, genforarbejdning eller gensterilisering af enheder til engangsbrug kan skabe risiko for krydkontaminering, patientinfektion, og/eller enhedsrigt. Efter brug skal komponenter beregnet til engangsbrug bortskaftes som infektiøst affald. Må ikke bruges, hvis den sterile pakke er beskadiget.

STERILE EO

Må ikke genbruges.

Rengøring, desinficering og sterilisering af genbrugelige anordninger**Rengøring**

Genanvendelige apparater skal renses omhyggeligt før de gennemgår steriliseringsprocessen. Husk, sterilisering eller desinficering på højt niveau kan ikke opnås med mindre samlingen er renset først.

1. Skyl overskydende snavs af anordningen.
2. Forbered den enzymatiske opløsning (såsom Enzol) i henhold til producentens anvisninger for korrekt opløsning.
3. Nedskær anordningen helt i opløsningen, og lad den ligge i blød i 10 minutter.
4. Efter anordningen har ligget i blød, børstes den grundigt med en blød børste. Rengør hulrum og huller med en børste af passende størrelse. En sprøjte kan benyttes til at skylle de områder, der er vanskelige at komme til på anordningen.
5. Skyl og tør anordningen grundigt. Benyt altid R/O (omvendt osmose) eller DI (deioniseret) vand til at skylle anordningen med. Vand fra hanen kan medføre, at den forarbejdede anordning bliver inficeret igen. Benyt en ren, blød klud til at tørre anordningen med.
6. Undersøg alle overflader grundigt for at sikre, at der ikke er synlige spor efter biobyrd. Hvis der er synlige dele på anordningen, gentages rengøring og tørring, indtil HELE anordningen er ren.

Anbefalinger for desinficering og sterilisering af genbrugelige anordninger af plastik eller anodiseret aluminium

Efter rensning ved at bruge anbefalingerne ovenfor Læg i blød i mindst 5 minutter i et neutralt pH Enzol Enzymatisk rensemiddel som lavet af *Johnson & Johnson*.

Sterilisering med Cidex Activated Dialdehyde, fx som fremstillet af *Johnson & Johnson* eller tilsvarende, godkendt steriliseringsmetode benyttet af steriliseringsafdelingen for tilsvarende anordninger.

Dampsterilisering af genbrugelige anordninger af rustfrit stål

Efter rengøring i henhold til nævnte anbefalinger dampsteriliseres (steriliseringstype – tyngde) i en autoklave ved mindst 132 grader celsius (270 grader fahrenheit) i mindst 15 minutter. Tør anordningen i mindst 25 minutter. Når der steriliseres flere instrumenter i en autoklavearbejdsgang, skal det sikres, at steriliseringssmaksimum ikke overskrides.

Advarsel

- Lange, små kanyleringer og blindhuller kræver ekstra omhyggelighed under rengøring.
- Genanvend eller behandler ikke apparater mærket til enkelbrug.
- Efter sterilisering, pak og opbevar apparatet forsvarligt for at være sikker på, at sterilitet ikke bliver kompromitteret for genbrug.
- Brug altid et sondeomslag for at formindske urenheder.

Kontrol og funktionstest

Kontroller visuelt for skader og slid. I tilfælde af instrumenter med hængsel kontrolleres at hængslets bevægelse er let, uden overdrevne "spillerum". Låsemekanismen bør kontrolleres for at sikre, at de fungerer.

Begrænsninger for efterbehandling


Gentagen efterbehandling har minimal effekt på disse anordninger. Levetiden bestemmes normalt af slid og skader som et resultat af brug.

For oversættelser af disse anvisninger gå til www.protekmedical.com.

Kontakt Protek Medical Products, Inc. for yderligere oplysninger.

Undtagelsesklausul:

Vejledningen givet ovenfor er godkendt af producenten af den medicinske anordning som brugbar ved forberedelse af en medicinsk anordning til genbrug. Det er brugerens ansvar at bestemme enhver form for afgivelser fra den anbefalede procesmetode og på dette vis vurdere effektiviteten og de potentielle, negative følger deraf.

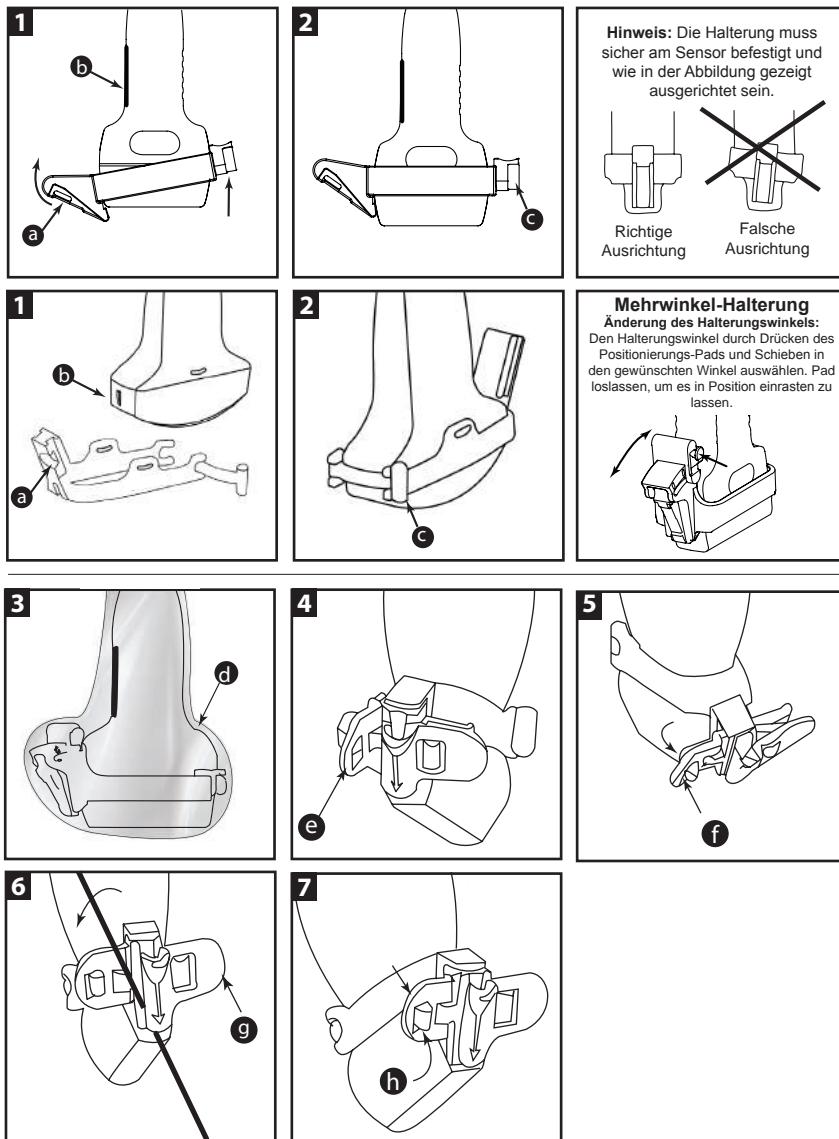**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Vorbereitung der Sonde gemäß Systemhandbuch. Die wiederverwendbare Halterung wird nicht steril mitgeliefert. Werden Leitlinien eines Systems verwendet, sollten Sie vor Anwendung der Nadel immer sicherstellen, dass die Nadel den Leitlinien entspricht.

! Nicht verwenden, wenn Halterung/Nadelführung nicht richtig passen. Vor der Verwendung anhand der nachstehenden Anweisungen reinigen/sterilisieren. Die erforderliche Nadellänge verwenden, um den Zielbereich zu erreichen.

Einzelwinkel-Biopsiehalterung/Mehrwinkel-Biopsiehalterung (Halterung ist wiederverwendbar)

- 1 Bringen Sie die Halterung (Stil variiert) am Sensor an und richten Sie dabei den Halterung der Nadelführung an der Halterung (a) mit der Scannerseite des Sensors (b) aus.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Halterung sicher an der Sonde befestigt ist (c).

universelle Einweg-Nadelführung

- 3 Tragen Sie das Gel auf die Innenseite der Schutzhülle und/oder auf den Schallkopf der Sonde auf. Ziehen Sie die Schutzhülle (d) über die Sonde und die Halterung. Sichern Sie die Schutzhülle mit den Bändern.
- 4 Setzen Sie die Nadelführung (e) wie abgebildet auf die Halterung mit dem Spannflügel in angehobener Stellung.
- 5 Drücken Sie den Spannflügel runter und dann auf den Sperrknopf (f), um die Nadelführung zu arretieren.
- 6 Zur Schnellauslösung der Nadel, drücken Sie auf den Spannflügel (g) der Nadelführung.
- 7 Ziehen Sie den Spannflügel hoch und auf den Sperrknopf (h), um die Nadelführung zu entfernen.

! Die Nadelführung ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. **Nicht wiederverwenden. Nicht resterilisieren. Die nochmalaige Verwendung, Bearbeitung oder Sterilisierung von Einmalprodukten kann zu einer Kreuzkontaminierung, der Infektion von Patienten bzw. einer Funktionsstörung des Produkts führen.** Die Einwegkomponenten nach der Verwendung als infektiösen Abfall entsorgen. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

STERILE EO

2 Nicht wiederverwenden.**Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von wiederverwendbaren Geräten****Reinigung**

Bevor wieder verwendbare Instrumente sterilisiert werden können, müssen sie gründlich gereinigt werden. Beachten Sie, dass eine Sterilisierung oder hochgradige Desinfektion erst dann möglich ist, wenn das Instrument gereinigt ist.

1. Spülen Sie Schmutz vom Gerät ab.
2. Bereiten Sie die Enzymlösung vor (beispielsweise Enzol), und befolgen Sie dabei die Herstelleranweisungen für die korrekte Verdünnung.
3. Tauchen Sie das Gerät vollständig in das Reinigungsmittel ein und lassen Sie es 10 Minuten einweichen.
4. Nach dem Einweichen bürsten Sie das Gerät sorgfältig mit einer weichen Bürste ab. Reinigen Sie Lumen und Öffnungen mit einer passenden Bürste. Verwenden Sie eine Spritze, um schwer erreichbare Bereiche des Gerätes zu spülen.
5. Spülen Sie das Gerät sorgfältig und lassen Sie es trocknen. Verwenden Sie immer die R/O (umgekehrte Osmose) oder DI (entionisiertes) Wasser, um das Gerät zu spülen. Leitungswasser könnte das wieder aufbereitete Gerät erneut verschmutzen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch, um das Gerät abzutrocknen.
6. Untersuchen Sie sorgfältig alle Oberflächen um sicherzugehen, dass keine sichtbaren Gesamtkeimzahlen zurückbleiben. Wenn auf dem Gerät noch sichtbare Teile zurückbleiben, wiederholen Sie Reinigung und Trocknen, bis das GESAMTE Gerät sauber ist.

Empfehlungen zur Desinfektion und Sterilisation von wiederverwendbaren Geräten aus Kunststoff oder anodisiertem Aluminium

Nach der Reinigung gemäß der oben empfohlenen Anleitung. Lassen Sie die Halterung mindestens 5 Minuten lang in einem enzymatischen Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, z.B. Enzol Enzymatic von Johnson & Johnson®, einweichen. Sterilisieren Sie mit Cidex aktivierter Dialdehyd-Lösung, wie sie von Johnson & Johnson hergestellt wird, oder mit einer ähnlichen zugelassenen Sterilisationsmethode, die von der Abteilung für Sterilisation für derartige Geräte genutzt werden.

Dampfsterilisierung von wiederverwendbaren Geräten aus Edelstahl

Nach der Reinigung nach den oben aufgeführten Empfehlungen führen Sie eine Dampfsterilisierung (Sterilisator vom Typ Gravität) in einem Autoclav bei mindestens 132 Grad Celsius (270 Grad Fahrenheit) und für mindestens 15 Minuten durch. Lassen Sie das Gerät für mindestens 25 Minuten trocknen.

Wenn Sie mehrere Instrumente in einem Autoclav-Zyklus trocknen, achten Sie bitte darauf, dass die Maximallast des Sterilisators nicht überschritten wird.

Achtung

- Lange, enge Kanülierungen und Sacklöcher brauchen besondere Aufmerksamkeit bei der Reinigung.
- Instrumente die für den Einmalgebrauch gekennzeichnet sind, dürfen nicht aufbereitet oder wieder verwendet werden.
- Nach der Sterilisierung sollte das Instrument ordnungsgemäß verpackt und so gelagert werden, dass die Sterilität vor einem erneuten Gebrauch nicht beeinträchtigt werden kann.
- Um Kontaminierungen zu minimieren, sollten Sie grundsätzlich eine Sonde n-Schutzhülle verwenden.

Inspektion und Funktionstest

Inspizieren Sie visual auf Schäden und Abnutzung. Bei klappbaren Instrumenten prüfen Sie auf sanfte Bewegung des Scharniers ohne zu viel „Spiel“ des Scharniers. Der Sperrmechanismus sollte auf Betätigung überprüft werden.

Einschränkungen bei der Wiederaufbereitung


Die wiederholte Verarbeitung hat minimale Auswirkung auf diese Geräte. Das Lebensende wird normalerweise von Abnutzung und Nutzungsschäden bestimmt.

Übersetzungen dieser Anweisungen sind zu finden auf www.protekmedical.com.

Weitere Informationen erhalten Sie von Protek Medical Products, Inc.

Hafungsausschluss:

Die oben genannten Anleitungen wurden vom Hersteller der Medizingeräte überprüft und als geeignet befunden, um ein medizinisches Gerät für die Wiederverwendung vorzubereiten. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, Abweichungen von der empfohlenen Verarbeitungsmethode zu beurteilen und ordnungsgemäß auf Effektivität und möglichen schädlichen Folgen zu bewerten.

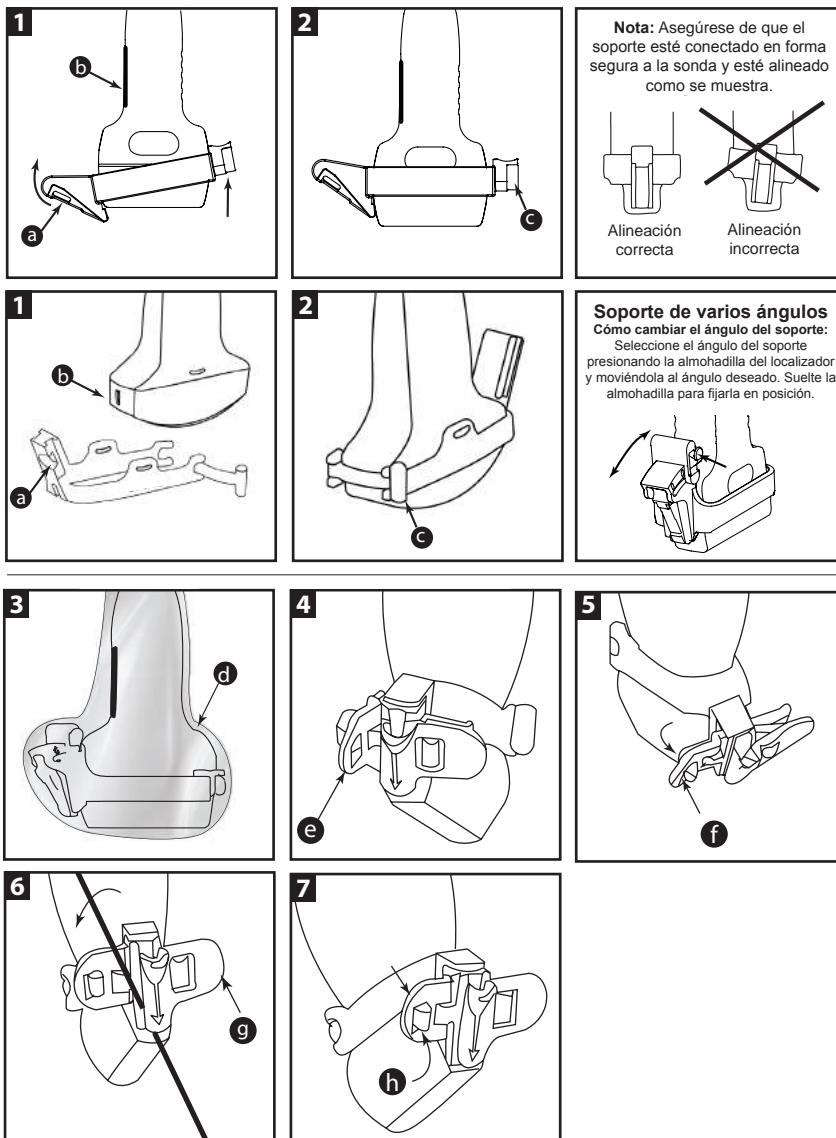**INSTRUCCIONES DE USO**




Prepare la sonda de acuerdo con el manual de operación del sistema. El soporte reutilizable se proporciona en estado no estéril. Cuando siga las pautas del sistema, verifique siempre que la aguja cumpla las pautas antes de usarla.

! Si la guía para aguja o el soporte no encajan correctamente, no los utilice. Límpielo y esterilícelo antes de utilizarlo, siguiendo las instrucciones recomendadas a continuación. Use el largo de aguja adecuado para llegar al área deseada.

Soporte de un ángulo para biopsia/Soporte de varios ángulos para biopsia (El soporte es reutilizable)

Fije el soporte (hay distintos estilos) a la sonda alineando el receptor de la guía de aguja en el soporte (a) con el extremo de escaneo de la sonda (b).

Verifique que el soporte quede firmemente conectado a la sonda.

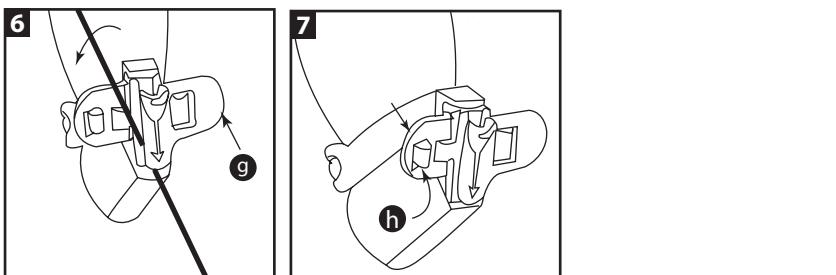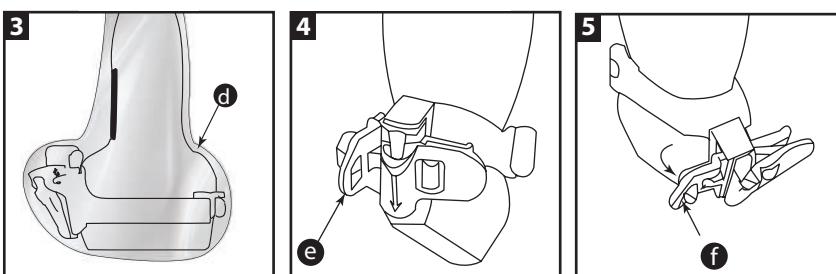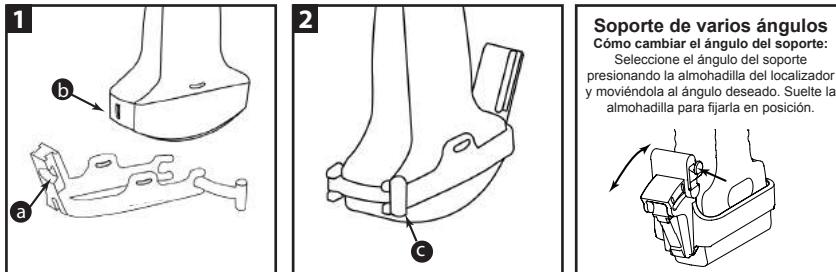**Guía de aguja para uso general desechable**

- 3 Coloque el gel dentro de la cubierta y/o en la superficie de exploración de la sonda. Coloque la cubierta de la sonda (d) sobre el conjunto de soporte y sonda. Asegure la cubierta con las bandas.
- 4 Coloque la guía de aguja (e) sobre el soporte como se muestra con el dispositivo de fijación en posición elevada.
- 5 Fije la guía de aguja en posición empujando el dispositivo de fijación hacia abajo y tirando del botón de fijación hacia arriba (f).
- 6 Para liberar rápidamente la aguja, presione el dispositivo de la guía de aguja (g).
- 7 Para retirar la guía de aguja, levante el dispositivo de fijación y presione el botón de fijación hacia abajo (h).

! La guía de aguja debe ser usada sólo una vez. **No vuelva a utilizar. Si se vuelven a usar, se re-procesan o se re-esterilizan dispositivos diseñados para usarse una sola vez, se puede crear un riesgo de contaminación cruzada, infección del paciente, y/o mal funcionamiento del dispositivo.**
Después del uso, deseche los componentes para un solo uso como residuos infecciosos. No utilice si el paquete estéril está dañado.

STERILE EO

No vuelva a utilizar.

Limpieza, desinfección y esterilización de dispositivos reutilizables**Limpieza**

Los dispositivos reutilizables deben ser limpiados completamente antes de someterlos al proceso de esterilización. Recuerde que no se podrá lograr una esterilización o desinfección de alto nivel a menos que se haya limpiado primero el conjunto.

- 1 Quite la tierra excedente del dispositivo enjuagándolo.
- 2 Prepare la solución enzimática (por ejemplo, Enzol) mediante las instrucciones del fabricante para obtener una dilución apropiada.
- 3 Sumerja el dispositivo completamente en el detergente y deje que se remoje durante diez minutos.
- 4 Luego, cepille bien el dispositivo con un cepillo de cerdas suaves. Limpie los lúmenes y los agujeros con un cepillo de tamaño apropiado. Se podría usar una jeringa para enjuagar las zonas del dispositivo que son difíciles de alcanzar.
- 5 Enjuague y seque bien el dispositivo. Para enjuagar el dispositivo, siempre utilice agua de ósmosis inversa o desionizada, ya que el agua del grifo puede volver a contaminar el dispositivo que se vuelve a utilizar. Utilice un paño suave y limpio para secar el dispositivo.
- 6 Inspeccione detalladamente todas las superficies para asegurarse de que no haya ningún grado de contaminación microbiana visible. Si observa alguna parte del dispositivo contaminada, vuelva a limpiar y secar el dispositivo hasta que esté limpio TOTALMENTE.

Recomendaciones para la desinfección y esterilización de dispositivos reutilizables de plástico o aluminio anodizado

Después de limpiar de acuerdo con las recomendaciones anteriores, sumerja por lo menos 5 minutos en un detergente enzimático con pH neutro como Enzol de Johnson & Johnson®. Esterilícelos con solución activada de dialdehido Cidex, como la elaborada por Johnson & Johnson, o mediante cualquier método de esterilización equivalente validado e implementado por el departamento de esterilización para dispositivos similares.

Esterilización al vapor de dispositivos reutilizables de acero inoxidable

Después de realizar la limpieza mediante las recomendaciones anteriores, esterilice el dispositivo al vapor (tipo de esterilizador: por gravedad) en una autoclave como mínimo a 132 °C (270 °F) durante un período mínimo de 15 minutos. Seque el dispositivo durante un período mínimo de 25 minutos.

Al esterilizar varios instrumentos en un ciclo de autoclave, asegúrese de no exceder la carga máxima del esterilizador.

Advertencia

- Es necesario prestar especial atención a las canalizaciones largas y estrechas y a los orificios sin salida.
- No utilice o reprocese nuevamente los dispositivos marcados como desechables.
- Después de esterilizar, empaque y almacené adecuadamente el dispositivo para garantizar que no se afecte la esterilización antes de reutilizarlo
- Use siempre una cubierta de sonda para minimizar la presencia de agentes contaminantes.

Inspección y prueba de funcionamiento

Realice una inspección visual para detectar daños y desgaste. En el caso de instrumentos abisagrados, verifique que la bisagra tenga movimiento continuo sin moverla excesivamente. Se debe verificar que funcionen los mecanismos de bloqueo.

Limitaciones sobre la cantidad de veces que se vuelve a utilizar el dispositivo


Si se repite el procedimiento, esto puede tener un efecto mínimo en los dispositivos. El fin de la vida útil en general se determina por el desgaste y los daños causados por el uso.

Para obtener las traducciones de estas instrucciones, visite www.protekmedical.com.

Para obtener más información, comuníquese con Protek Medical Products, Inc.

Descargo de responsabilidad:

El fabricante del dispositivo médico ha validado las instrucciones proporcionadas más arriba y ha indicado que son útiles para preparar un dispositivo médico para volver a utilizarlo. Es responsabilidad del usuario calificar cualquier desviación del método de proceso recomendado y evaluar correctamente la eficacia y las posibles consecuencias adversas.

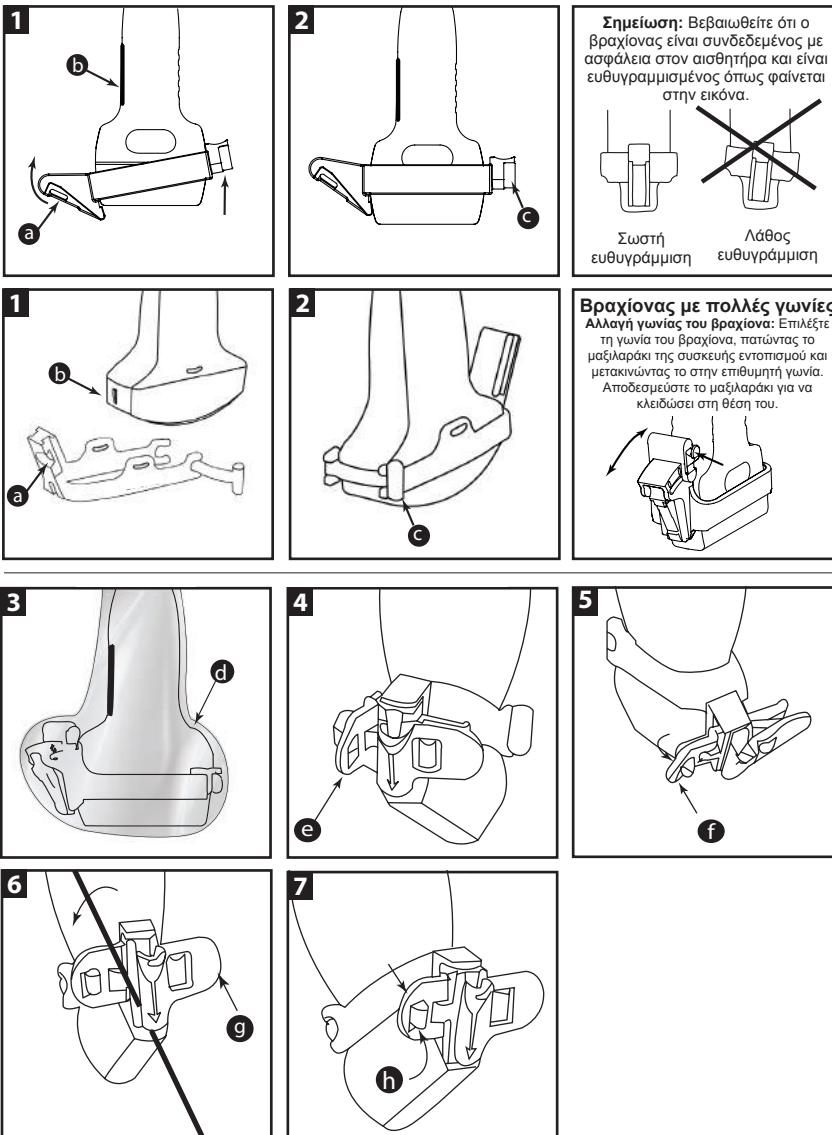**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Προετοιμάστε τη μήλη σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας. Το επαναχρησιμοποιήσιμο άγκιστρο παρέχεται μη αποστειρωμένο. Οταν χρησιμοποιείτε τις οδηγίες συστήματος, βεβαιώστε πάντοτε πως η βελόνα ακολουθεί την οδηγία πριν από τη χρήση.

! Εάν ένας βραχίονας/οδηγός βελόνας δεν εφαρμόζει σωστά, μην τον χρησιμοποιήσετε. Καθρέστε το άγκιστρο τηρώντας τις συνιστώμενες οδηγίες παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μήκος βελόνας για να φτάσετε στην περιοχή στόχου.

Μονός βραχίονας βιοφίας με γυνία/Βραχίονας βιοφίας με πολλές γυνίες (Ο βραχίονας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά)

- Προσαρτήστε το άγκιστρο (τα στυλ διαφέρονταν) στην υπόδοχή του οδηγού βελόνας ευθυγράμμισης με τον αισθητήρα (a) με την όψη σάρωσης του αισθητήρα (b).
- Σιγουρευτείτε ότι το άγκιστρο έχει συνδεθεί ασφαλώς με τη μήλη (c).

Οδηγός βελόνας μίας γενικής χρήσης

- Βάλτε τη γέλη εντός του καλύμματος ή / και στην επιφάνεια σάρωσης της μήλης. Τοποθετήστε το κάλυμμα μήλης (d) επάνω από τη διάταξη μήλης και αγκιστρου. 5. Ασφαλίστε το κάλυμμα με λαστιχάκια.
- Τοποθετήστε τον οδηγό βελόνας (e) στο άγκιστρο όπως απεικονίζεται με το επίθεμα ασφάλισης σε ανυψωμένη θέση.
- Κλειδώστε τον οδηγό βελόνας στη θέση του σπρώχνοντας προς τα κάτω το επίθεμα ασφάλισης και προς τα πάνω στο κουμπί ασφάλισης (f).
- Για ταχεία άφεση της βελόνας, πιέστε το επίθεμα οδηγού βελόνας (g).
- Για να αφαιρέστε τον οδηγό βελόνας, τραβήξτε το επίθεμα ασφάλισης προς τα πάνω και προς τα κάτω στο κουμπί ασφάλισης (h).

! Ο οδηγός βελόνας ενδεικνύεται για μια μόνο χρήση. **Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε. Μην επαναποστειρώνετε.** Επαναχρησιμοποίηση, επανεπεξεργασία ή επαναποστειρώση των συσκευών μίας χρήσης ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο επιμόλυνσης, λοίμωξης στον ασθενή ή/και δυσλειτουργίας της συσκευής. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τα στοιχεία μονής χρήσης ως μολυντικά απορρίμματα. Μη χρησιμοποιείτε αν η αποστειρωμένη συσκευασία είναι κατεστραμμένη.

STERILE EO

② Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευών**Καθαρισμός**

Οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευές πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά προτού υπόκεινται σε διαδικασία αποστειρώσης. Λάβετε υπόψη, ότι δεν μπορείτε να επιτύχετε αποστείρωση ή απολύμανση υψηλού επιπέδου παρά μόνον εάν η διάταξη καθαρίστε πρότα παρόλα.

1. Ξεπλύνετε τις ορατές ακαθαρίσεις από τη συσκευή.
2. Προετοιμάστε το ενζυματικό διάλυμα (όπως την Enzol), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή αραίωση.
3. Βιθίστε εντελώς τη συσκευή μέσα στο απορρυπαντικό και αρήστε τη να μοιλιάσει για 10 λεπτά.
4. Μετά το μοιλασμα, βουρτσίστε τη συσκευή σχολαστικά, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες. Καθαρίστε τους αιλούς και τις οπές με μια βούρτσα κατάλληλου μεγέθους. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε μια σύριγγα για εκπλύση των διαπρόσθιων σημείων της συσκευής.
5. Ξεπλύνετε σχολαστικά και στεγνώστε τη συσκευή. Πάντα να χρησιμοποιείτε νερό A/O (αντιστροφής όσμωσης) ή απονισμένο νερό για να ξεπλύνετε τη συσκευή. Το νερό της βρύσης μπορεί να επαναμολύνει την επανεπεξεργασμένη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό στεγνό πανί για να στεγνώσετε τη συσκευή.
6. Εξετάστε σχολαστικά όλες τις επιφάνειες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατά υπολείμματα βιολογικής επιβύρυνσης. Αν παρατηρήθουν ορατά σωματίδια στη συσκευή, επαναλάβετε τον καθαρισμό και το στέγνωμα, μέχρι να είναι καθαρή ΟΛΟΚΛΗΡΗ η συσκευή.

Συστάσεις για την απολύμανση και την αποστείρωση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευών από πλαστικό ή αναδιορισμένο αλυσίδιο

Μετά το καθαρίσιμο χρησιμοποιούμε τις ανοτέρω συστάσεις Βιθίστε τη συσκευή σε Ενζυματικό απορρυπαντικό ουδέτερου pH όπως αυτό που κατασκευάζεται από την Johnson & Johnson® επί 5 λεπτά τον/λαζίστον.

Αποστειρώστε με διάλυμα ενεργού διαλδεύδης Cidex όπως αυτό που παρασκευάζεται από την Johnson & Johnson ή οποιαδήποτε ισοδύναμη επικυρωμένη μέθοδο αποστείρωσης έχει υιοθετηθεί από το τιμήμα αποστείρωσης για παρόμοιες συσκευές.

Αποστείρωση με ατμό επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευών από ανοξείδωτο χάλυβα

Μετά τον καθαρισμό με τήρηση των παραπάνω συστάσεων, αποστειρώστε με ατμό (με αποστειρωτή βαρυτικού τύπου) σε αυτόκαυστο με ελάχιστη θερμοκρασία 132 βαθμών Κελσίου (270 βαθμών Φάρενχαϊτ) τουλάχιστον για 15 λεπτά. Στεγνώστε τη συσκευή τουλάχιστον για 15 λεπτά.

Οταν αποστειρώνετε πολλά εργαλεία στον ίδιο κύκλο του αυτόκαυστου, φροντίστε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο του αποστειρωτή.

Προειδοποίηση

- Οι μεγάλους μήκους στενές διαστολήνσιες και οι τυφλές οπές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε ούτε να υποβάλλετε σε επανεπεξεργασία συσκευές που είναι σε στηματισμένες ως μιας χρήσης.
- Μετά την αποστείρωση, συσκευάστε κατάλληλα και αποθηκεύστε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι διατηρείται η αποστείρωση πριν από την επόμενη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κάλυμμα μήλης για να ελαχιστοποιήσετε τις μολυσματικές ουσίες.

Επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας

Επιθεωρήστε οπτικά για ζημιά και φθορές. Για άργα μεσαία μεταβολή στην ιατρική συσκευής, αποτελεί ενδιαφέροντα σημάδια για την προετοιμασία μίας χρήσης. Οι μηχανισμοί ασφάλισης πρέπει να ελέγχονται ως προς τη σωστή τους λειτουργία.












Περιορισμοί για την επανεπεξεργασία

Η επανελαμμένη επεξεργασία έχει ελάχιστες επιπτώσεις σε αυτές τις συσκευές. Συνήθως, το τέλος της αφέλμητης διάρκειας ζωής προσδιορίζεται από τις φθορές και ζημιές που οφείλονται στη χρήση.

Για μεταφορές αντών των οδηγών, μεταβείτε στη σελίδα www.protekmedical.com. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Protek Medical Products, Inc.

Αποποίηση ευθύνης:

Οι οδηγίες που παρέχονται παραπάνω έχουν επικυρωθεί από τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής ως ικανές για την προετοιμασία μίας ιατρικής συσκευής για επαναχρησιμοποίηση. Αποτελεί ευθύνη της χρήστη την καταλλήλωτη ταχύτητα παρεκκλίσης από τη συντομότερη μέθοδο επεξεργασίας και να αξιολογήσει κατάλληλα την αποτελεσματικότητά τους και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους.

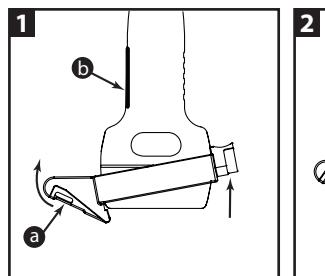

MODE D'EMPLOI

Préparer la sonde selon le manuel de fonctionnement du système. Le bracelet n'est pas emballé stérilement ; il est réutilisable. Lorsque vous utilisez les directives du système, toujours vérifier que l'aiguille est conforme à ces directives avant de l'utiliser.

! Si le support/le guide-aiguille n'a pas la bonne dimension, ne l'utilisez pas. Nettoyer le support selon les instructions suivantes. Utilisez la longueur d'aiguille appropriée pour atteindre la région cible.

Support à angle unique/Support multi-angle pour biopsie (Le support est réutilisable)

- 1 Fixez le support (le style peut varier) à la sonde en alignant le récepteur du guide-aiguille du support (a) avec le côté numérisateur de la sonde (b).
- 2 Vérifier que le support est bien fixé à la sonde (c).

Guide-aiguille universel jetable

- 3 Mettre du gel dans le capuchon ou sur la surface d'exploration de la sonde. Placer le capuchon de sonde (d) sur l'ensemble de la sonde et du support. Fixer le capuchon avec des bandes.
- 4 Placer l'aiguille-guide (e) sur le support comme indiqué avec le coussinet de blocage en position élevée.
- 5 Verrouiller l'aiguille-guide en position en abaissant le coussinet et en le relevant dans le bouton de verrouillage (f).
- 6 Pour dégager rapidement l'aiguille, appuyer sur le coussinet de l'aiguille-guide (g).
- 7 Pour retirer l'aiguille guide, tirer le coussinet vers le haut puis vers le bas le bouton de verrouillage (h).

! Une aiguille-guide ne sert qu'une seule fois. **Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation de dispositifs à usage unique peuvent présenter un risque de contamination croisée, d'infection du patient et / ou de dysfonctionnement du dispositif.** Après l'utilisation, éliminez les composants à usage unique comme déchets infectieux. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

STERILE EO

Ne pas réutiliser.

Nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs réutilisables

Nettoyage

Il faut soigneusement nettoyer les instruments réutilisables avant de les soumettre au processus de stérilisation. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas effectuer de stérilisation ou de désinfection radicales à moins que l'ensemble ne soit d'abord nettoyé.

1. Nettoyez tout excès de salissure sur le dispositif.
2. Préparez la solution enzymatique (ex. : Enzol) conformément aux instructions du fabricant pour obtenir une dilution adéquate.
3. Immergez entièrement le dispositif dans le détergent et laissez tremper pendant 10 minutes.
4. Après l'avoir laissé tremper, brossez le dispositif en profondeur à l'aide d'une brosse souple. Nettoyez les lumières et les orifices à l'aide d'une brosse de taille adaptée. Vous pouvez utiliser une seringue pour rincer les zones difficiles à atteindre du dispositif.
5. Rincez en profondeur le dispositif et séchez-le. Utilisez toujours de l'eau OI (osmose inversée) ou de l'eau déminéralisée pour rincer le dispositif. L'eau du robinet risque de contaminer le dispositif retrouvé. Servez-vous d'un chiffon doux propre pour essuyer le dispositif.
6. Inspectez en profondeur toutes les surfaces pour vous assurer qu'il ne reste aucune trace biologique visible. Si vous observez des traces sur le dispositif, répétez les procédures de nettoyage et de séchage jusqu'à ce que l'ENSEMBLE du dispositif soit propre.

Recommandations pour la désinfection et la stérilisation des dispositifs réutilisables en plastique ou en aluminium anodisé

Après un nettoyage selon les recommandations précédentes Faire tremper pendant au moins 5 minutes dans un détergent enzymatique Johnson & Johnson au pH neutre comme celui de Johnson & Johnson®. Stérilisez à l'aide d'une solution de dialdéhyde activé Cidex, telle que celle fabriquée par Johnson & Johnson, ou n'importe quelle autre méthode de stérilisation équivalente validée et adoptée par le service de stérilisation pour de tels dispositifs.

Stérilisation à la vapeur des dispositifs réutilisables en acier inoxydable

Après le nettoyage à l'aide des recommandations susmentionnées, procédez à une stérilisation à la vapeur (type de stérilisateur : gravité) dans un autoclave à 132 degrés Celsius minimum pendant au moins 15 minutes. Faites sécher le dispositif pendant au moins 25 minutes.

Lorsque vous stérilisez plusieurs instruments dans un seul cycle d'autoclave, assurez-vous de ne pas dépasser la charge maximale du stérilisateur.

Avertissement

- Les rainures longues et étroites, ainsi que les trous borgnes nécessitent une attention particulière pendant le nettoyage.
- Ne pas réutiliser ou traiter les instruments pour une utilisation unique.
- Après stérilisation, emballer et ranger adéquatement l'instrument pour garantir sa stérilité avant une réutilisation.
- Toujours utiliser un capuchon de sonde pour minimiser la contamination.

Inspection et test du fonctionnement

Inspectez visuellement la présence de dommages et d'usure. Pour les instruments articulés, vérifiez le bon mouvement des charnières sans excès de « jeu ». Vérifiez le bon fonctionnement des mécanismes de verrouillage.

Limites du retraitement











La répétition du retraitement a un effet minime sur ces dispositifs. La fin de vie est normalement déterminée par l'usure et les dommages causés par l'utilisation.

Pour la traduction de ces instructions, consultez le site www.protekmedical.com.

Pour plus d'informations, contactez Protek Medical Products, Inc.

Limite de responsabilité :

Les instructions fournies ci-dessus ont été validées par le fabricant du dispositif médical comme étant adaptées à la préparation d'un dispositif médical en vue de sa réutilisation. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'apporter des modifications à la méthode recommandée de traitement et d'en évaluer correctement l'efficacité et les éventuelles conséquences néfastes.

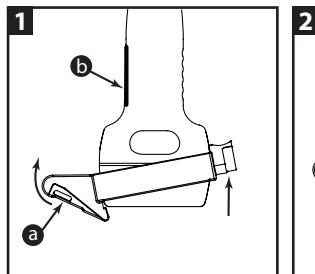

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la sonda per il funzionamento manuale del sistema. La staffa multiuso viene fornita non sterile. Quando si utilizzano le direttive del sistema, prima dell'uso verificare sempre che l'ago segua la linea guida.

! Non utilizzare la staffa/il guida-ago se non si adattano correttamente. Detergere/sterilizzare la staffa prima dell'uso, attenendosi alle istruzioni consigliate di seguito. Per raggiungere l'area interessata, utilizzare un ago della lunghezza corretta.

Staffa per biopsia angolo singolo/Staffa per biopsia multiangolo (La staffa è riutilizzabile)

- 1 Collegare la staffa (in base allo stile) alla sonda, allineando il recettore del guida-ago sulla staffa (a) con il lato scansione della sonda (b).
- 2 Accertarsi che il supporto sia saldamente fissato alla sonda (c).

Guida-ago multifunzione usa e getta

- 3 Mettere il gel all'interno del coperchio e/o sulla superficie di scansione della sonda. Posizionare il coperchio della sonda (d) sull'unità sonda e supporto. Fissare il coperchio con le bande.
- 4 Posizionare il guida ago (e) sul supporto come mostrato con il cuscinetto di bloccaggio in posizione elevata.
- 5 Bloccare il guida ago in posizione spingendo verso il basso il cuscinetto di bloccaggio e verso l'alto il pulsante di bloccaggio (f).
- 6 Per rilasciare rapidamente l'ago, premere il cuscinetto del guida ago (g).
- 7 Per rimuovere il guida ago, alzare il cuscinetto di bloccaggio e abbassare il pulsante di bloccaggio (h).

! Il guida ago è monouso. **Non riutilizzare. Non risterilizzare. Il riutilizzo, la rilavorazione o la ri-sterilizzazione di questo dispositivo monouso può creare il rischio di contaminazione incrociata, infezioni ai paziente e/o un malfunzionamento del dispositivo.**
Dopo l'uso, smaltire i componenti monouso come rifiuti infetti. Non utilizzare se la confezione sterile è danneggiata.

STERILE EO

Non riutilizzare.

Detergere, disinsettare e sterilizzare i dispositivi riutilizzabili

Detergente

I dispositivi riutilizzabili devono essere accuratamente puliti prima di essere sottoposti al processo di sterilizzazione. Ricordarsi di non effettuare la sterilizzazione o una disinfezione approfondita senza aver prima pulito l'unità.

1. Sciacquare lo sporco in eccesso dal dispositivo.
2. Preparare la soluzione enzimatica (ad es. Enzol), seguendo le istruzioni del produttore per una corretta diluizione.
3. Immergere completamente il dispositivo nel detergente e lasciare in ammollo per 10 minuti.
4. Dopo l'ammollo, spazzolare accuratamente il dispositivo con una spazzola a setole morbide. Pulire i lumi e i fori con una spazzola di dimensioni adeguate. Per sciacquare le aree del dispositivo difficili da raggiungere, utilizzare una siringa.
5. Risciacquare e asciugare accuratamente il dispositivo. Per sciacquare il dispositivo, utilizzare sempre acqua iperfiltrata (RO, osmosi inversa) o deionizzata; l'acqua del rubinetto potrebbe ricontaminare il dispositivo ritrattato. Asciugare il dispositivo con un panno morbido.
6. Esaminare accuratamente tutte le superfici per assicurarsi che non sia rimasta alcuna carica batterica visibile. Se è presente una carica batterica su parte del dispositivo, ripetere la detersione e l'asciugatura fino a quando TUTTO il dispositivo è pulito.

Consigli per la disinfezione e la sterilizzazione di dispositivi multiuso in plastica o in alluminio anodizzato

Dopo aver effettuato la pulizia come riportato sopra, immergere i dispositivi per 5 minuti minimo in un detergente enzimatico a pH neutro come quello prodotto da Johnson & Johnson®. Sterilizzare con una soluzione dialide attivata Cidex come quella di Johnson & Johnson, o con qualsiasi altro metodo di sterilizzazione approvato equivalentemente adottato dal reparto di sterilizzazione per dispositivi simili.

Sterilizzazione a vapore dei dispositivi multiuso in acciaio inossidabile

Una volta eseguita la pulizia in base ai consigli riportati sopra, sterilizzare a vapore (tipo di sterilizzatore a gravità) in un'autoclave ad almeno 132 °C (270 °F) per almeno 15 minuti. Asciugare il dispositivo per almeno 25 minuti. Quando si sterilizzano più strumenti in un ciclo di autoclave, assicurarsi che non venga superato il carico massimo dello sterilizzatore.

Avvertenza

- Le incannulazioni lunghe e sottili e i fori ciechi richiedono un'attenzione particolare durante la procedura.
- Non riutilizzare o sottoporre a procedura i dispositivi monouso.
- Dopo la sterilizzazione, imballare accuratamente i dispositivi e riporli per accertarsi che la sterilità non venga compromessa prima dell'uso.
- Utilizzare sempre il coperchio della sonda per ridurre al minimo i rischi di contaminazione.

Ispezione e test di funzionamento

Ispezionare visivamente per accettare la presenza di danni e usura. Per gli strumenti dotati di cerniera, verificare il movimento fluido della cerniera e l'assenza di un "gioco" eccessivo. Controllare il funzionamento dei meccanismi di blocco.

Limitazioni del ritrattamento


Il trattamento ripetuto ha un impatto minimo su questi dispositivi. La messa fuori servizio è generalmente determinata dall'usura e da danni causati dall'uso.

Per le traduzioni delle presenti istruzioni, visitare il sito Web www.protekmedical.com.

Per maggiori informazioni, contattare Protek Medical Products, Inc.

Declinazione di responsabilità

Le istruzioni riportate sopra sono state approvate dal produttore del dispositivo medico e confermano la capacità di preparare un dispositivo medico per il riutilizzo. È responsabilità dell'utente specificare le eventuali deviazioni dal metodo di trattamento consigliato e di valutare correttamente l'efficacia e le potenziali conseguenze avverse.

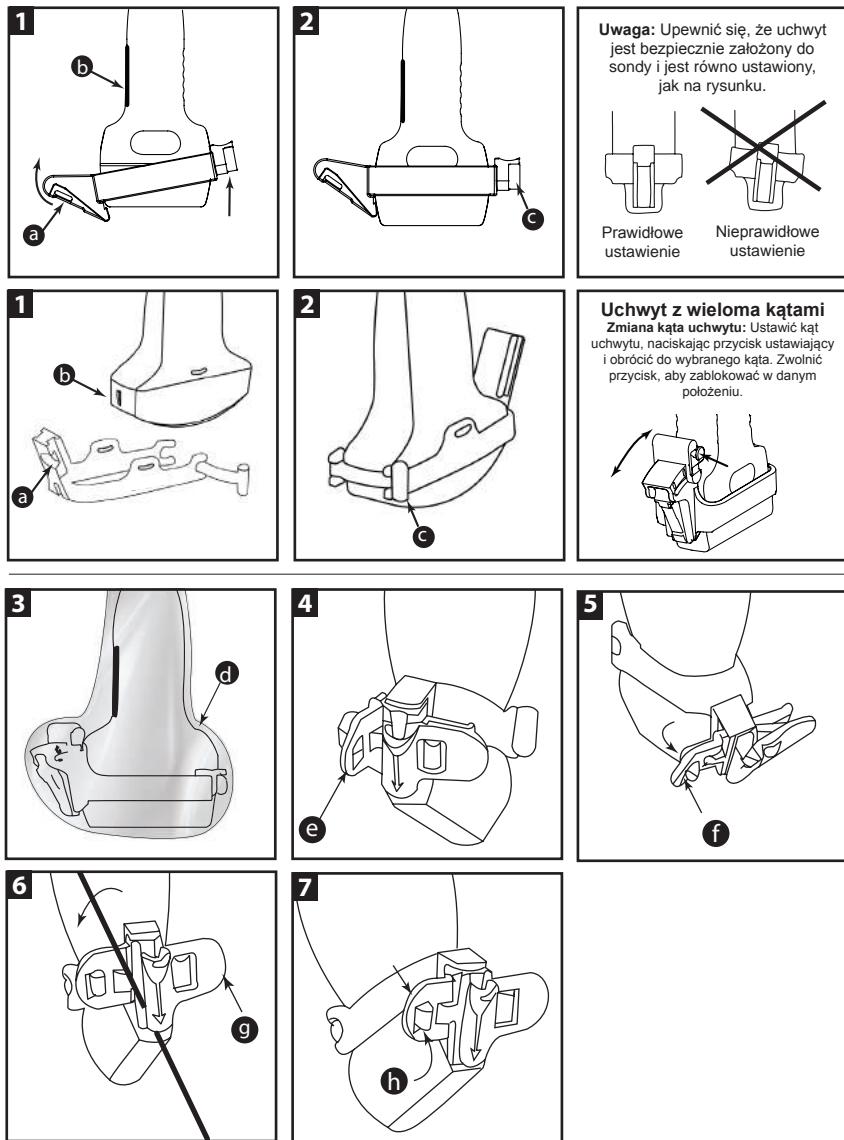**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przygotować próbnik zgodnie z instrukcjami obsługi systemu. Uchwyt wielokrotnego użytku jest niesterylny. Wykorzystując zasady systemu, zawsze przed użyciem należy upewnić się, że igła jest zgodna z zasadami.

⚠ Nie stosować, jeżeli uchwyt/prowadnica igieł jest niewłaściwie dopasowana. Przed pierwszym użyciem wyczyścić/wysterylizować uchwyt zgodnie z niżej podanymi zaleceniami. Do naklucia docelowego rejonu używać igieł o odpowiedniej długości.

Uchwyt do biopsji ze stałym kątem/Uchwyt do biopsji pod wieloma kątami (Uchwyty można używać wielokrotnie)

- 1 Połączyc uchwyt (style połączeń różnią się) z sondą, osiując odbierak prowadnicy igieł na uchwycie (a) ze stroną skanującą sondy (b).
- 2 Upewnić się, że wspornik jest dobrze podłączony do próbnika (c).

Uniwersalna prowadnica igieł jednorazowego użytku

- 3 Umieścić żel we wnętrzu pokrywy oraz / lub na powierzchni skanującej próbnika. Umieścić pokrywę próbnika (d) nad zestawem próbnika i wspornika. Zabezpieczyć pokrywę przy pomocy taśm.
- 4 Umieścić prowadnik igły (e) na wsporniku, jak pokazane, przy pomocy podkładki blokującej w pozycji podniesionej.
- 5 Zablokować prowadnik igły w pozycji przez naciśnięcie podkładki blokującej i wyciszczenie w góre przycisku blokującego (f).
- 6 Aby szybko wyjąć igłę, należy nacisnąć podkładkę prowadnika igły (g).
- 7 Aby usunąć prowadnik igły, wyciągnąć podkładkę blokującą i nacisnąć przycisk blokujący (h).

⚠ Prowadnik igły jest tylko do jednorazowego użycia. Nie stosować powtórnie. Nie sterylizować ponownie. Powtórne wykorzystanie, przetworzenie lub sterylizacja narzędzi jednorazowego użytku mogą spowodować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, zakażenia pacjenta i / lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Elementy jednorazowego użytku należy utylizować po użyciu jak odpady zakaźne. Nie stosować w przypadku uszkodzenia sterylnego opakowania.

STERILE EO**Nie stosować powtórnie.****Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu wielokrotnego użytku****Czyszczenie**

Urządzenia do powtórnego użycia muszą być dokładnie wymyte przed podaniem ich procesowi sterylizacji. Należy pamiętać, że nie osiągnie się pełnej sterylizacji ani wysokiego poziomu dezynfekcji jeżeli zestaw nie jest uprzednio wymyty.

1. Splukać z urządzenia widoczne zanieczyszczenia.
2. Przygotować roztwór enzymatyczny (np. Enzolu), zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi prawidłowego rozcieńczania.
3. Całkowicie zanurzać urządzenie w detergencie i wymacać przez 10 minut.
4. Po wymyczeniu, dokładnie wyszorować urządzenie, używając szczotki o miękkim włosiu. Szczotką o odpowiednim rozmiarze wyczyścić lumeny i otwory. Do przepukania trudno dostępnych miejsc można użyć strzykawki.
5. Urządzenie dokładnie wypłukać i wysuszyć. Do plukania urządzenia zawsze używać R/O (odwróconej osmozy) lub wody DI (dejoniżowanej), woda z kranu może ponownie zanieczyszczyć oczyszczone urządzenie. Urządzenie osuszyć miękką szmatką.
6. Dokładnie zbadać wszystkie powierzchnie, aby upewnić się, że nie pozostały żadne widoczne zanieczyszczenia biologiczne. Jeśli widoczne są jakiekolwiek zanieczyszczenia urządzenia, należy powtórzyć czyszczenie i suszenie, a CALE urządzenie będzie czyste.

Zalecenia dotyczące dezynfekcji i sterylizacji urządzeń wielokrotnego użytku, wykonanych ze sztucznego tworzywa lub aluminium anodowanego

Po wymyciu z zastosowaniem powyższych zaleceń, Wymoczyć przez co najmniej 5 minut w enzymatycznym środku czyszczącym o neutralnym pH Enzolu, takim jak produkowane przez Johnson & Johnson®. Wysterylizować w roztworze czynnego didehydu Cidex, produkowanego przez Johnson & Johnson® lub stosując inne sprawdzone metody sterylizacji takich urządzeń, przyjęte po wydział sterylizacji.

Sterylizacja parowa urządzeń wielokrotnego użytku wykonanych ze stali nierdzewnej

Po czyszczeniu z zastosowaniem powyższych zaleceń, przez co najmniej 15 minut sterylizować parowo (typ sterylizatora - gravitacyjny) w autoklawie w temperaturze wynoszącej co najmniej 132 stopni Celcjusza (270 stopni Fahrenheita). Urządzenie należy suszyć przez co najmniej 25 minut. Podczas sterylizacji wielu instrumentów w jednym cyklu autoklawu, nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia sterylizatora.

Ostrzeżenie

- Podczas czyszczenia szczególnej uwagi wymagają długie, wąskie kaniulacje i ślepe otwory.
- Nie używać ponownie i nie odzyskiwać urządzeń oznaczonych jako urządzenia do jednorazowego użycia.
- Po sterylizacji, urządzenie powinno być zapakowane i przechowywane w odpowiedni sposób, aby zapewnić, że sterylizacja nie zostanie zniweczyona przed użyciem.
- Zawsze używać pokrywy próbnika, aby zminimalizować zanieczyszczenia.

Kontrola i testowanie działania

Wzrokowo sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń i oznak zużycia. W przypadku instrumentów przegubowych, sprawdzać płynność ruchu przegubów, bez nadmiernego luzu. Sprawdzać działanie mechanizmów blokujących.

Ograniczenie poddawania obróbce











Wielokrotna obróbka ma minimalny wpływ na te urządzenia. Zakończenie okresu użytkowania urządzenia jest zazwyczaj ustalone na podstawie jego zużycia i uszkodzenia.

Inne wersje językowe tej instrukcji można znaleźć na stronie www.protekmedical.com.

Więcej informacji można uzyskać w firmie Protek Medical Products, Inc.

Wylęczenie odpowiedzialności:

Podane powyżej instrukcje zostały zatwierdzone przez producenta urządzeń medycznych, jako przygotowujące wyrób medyczny do ponownego użycia. Użytkownik odpowiada za wszelkie odstępstwa od zalecanych metod obróbki i właściwą ocenę skuteczności i potencjalnych skutków niepożądanych.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítse elő a szondát az eszköz használati utasításának megfelelően. A többször használatos tartót nem steril állapotban forgalmazzuk. Irányelvez alkalmazása esetén a felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a tű megfelel-e az előírásoknak.

! Ha a tartó/tüvezető nem illik tökéletesen össze, ne használják. Első használat előtt tisztítja meg/sterilizálja a tartót az alábbi utasításoknak megfelelően. Megfelelő hosszúságú tűt használjon a célerület eléréséhez.

Megadott (nem állítható) szögű/Állítható szögű biopsziás tartó (A tartó többször felhasználható)

- Csatlakoztassa a tartót (különböző stílusok) a szondához, egy vonalba állítva a tüvezető tartóján található foglalatot (a) a szonda képkötő oldalával (b).
- Ellenőrizze a tartókeret megfelelő rögzítettségét (c).

Útmutató az egyszer használatos, általános használatú tű alkalmazásához

- A gélt a védősapkába és/vagy a szonda vizsgálófejére kell helyezni. A védősapkát (d) húzza rá a szondára és a tartókeretre is. Gumigyűrűvel rögzítse a védősapkát.
- Helyezze rá a tüvezetőt (e) a tartókeretre az ábrának megfelelően úgy, hogy a rögzítőelem a felső pozícióban legyen.
- A tüvezető rögzítéséhez nyomja lefelé a rögzítőelemet és felfelé a rögzítőgombot (f).
- A tű gyors felengedéséhez nyomja meg a tüvezető fület (g).
- A tüvezető eltávolításához nyomja felfelé a rögzítőelemet és lefelé a rögzítőgombot (h).

! A tüvezető csak egyszeri felhasználásra alkalmas. Ne használja fel újra. Ne sterilizálja újra. Az egyszer használatos eszközök újból használata, újrafelhasználása, vagy újratermelésben szennyezés-átvitellel, a páciens fertőződésével és / vagy az eszközibás működésével járhat.

Használat után az egyszer használatos eszközöket fertőző hulladékként kell kezelni. Ne használja, ha sérült a csomagolás.

STERILE EO

Ne használja fel újra.

A többször használatos eszközök tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása

Tisztítás

Az újrafelhasználható eszközöket a sterilizálás előtt alaposan meg kell tisztítani. Ne felejtse el, hogy megfelelő tisztítás nélkül a sterilizálás és a magas szintű fertőtlenítés nem valósítható meg.

- Mossa le a szennyeződéseket az eszközről.
- Készítse el az enzimes oldatot (például Enzol) a gyártó megfelelő hígításra vonatkozó utasításai szerint.
- Merítse bele teljesen az eszközöt a tisztítószerbe, és hagyja ázni 10 percig.
- Aztatást követően tisztítja meg alaposan az eszközöt egy sertéssörkés kefivel. Tisztítja meg a lumeneket és a nyílásokat egy megfelelő méretű kefivel. Az eszköz nehezen hozzáérhető részeit mosssa át egy fejfendő segítségével.
- Öblítse le és száritsa meg alaposan az eszközöt. Az eszköz öblítésére mindenkor ózmózisos vagy deionizált vizet használjon, mivel a csapvíz ismét beszennyezheti az újrafeldolgozott férgeket. Az eszköz száritásához használjon puha és szárt törlőkendőt.
- Vizsgálja meg alaposan a termék minden felületét, megbizonyosodva arról, hogy nem látható semmilyen biterhelés. Bármilyen látható rész észlelése esetén ismételje meg a tisztítást és a száritást, amíg a TELJES eszköz tisztá nem lesz.

A többször használatos műanyag vagy anodizált aluminium eszközök fertőtlenítésére és sterilizálására vonatkozó ajánlások

A fenti javaslatoknak megfelelő tisztítás után, legalább 5 percre áztassa semleges pH -jú enzimatikus fertőtlenítőszere (ilyen pl. a Johnson & Johnson® által gyártott Enzol).

A sterilizálást végezte aktivált dialdehid Cidex oldattal, mint például a Johnson & Johnson terméke, vagy bármilyen más egyenértékű sterilizálási módszerrel, amelyet a hasonló eszközök sterilizációs részlege jóváhagyott.

A többször használatos rozsdamentes acél eszközök gőzös sterilizálása

A fenti utasításoknak megfelelő tisztítás elvégzését követően végezzen gőzös sterilizálást (gravitációs típusú sterilizátor) egy autoklávban, legkevesebb 132 Celsius fokon (270 Fahrenheit fok), minimum 15 percig. Száritsa az eszközöt minimum 25 percen keresztül.

Amennyiben egyszerre több műszerét sterilizál egy autokláv ciklusban, győződjön meg arról, hogy nem lépte túl a sterilizátor maximális terhelhetőségét.

Figyelem

- A hosszú és vékony kanáluk és a vaknyílások különös figyelmet igényelnek a tisztítás során.
- Ha a termék a leírás alapján egyszer használásától, ne használja fel újra és ne fertőtlenítse.
- A sterilizálás után megfelelően csomagolja el és tárolja az eszközöt úgy, hogy a következő használatig a sterilítás fennmaradjon.
- A kontamináció minimalizálása érdekében mindenkor helyezzen a szondára védősapkát.

Vizsgálat és működési ellenőrzés

Szemrevételezzel vizsgálja meg az eszközöt sérülések és kopások után kutatva. Csuklós műszerek esetén ellenőrizze a csukló akadálymentes, tüzető játék nélküli mozgását. Vizsgálja meg a záró mechanizmusok működését.

Újrafeldolgozásra vonatkozó korlátozások


Az ismétlődő feldolgozás minimális hatással van ezekre az eszközökre. Élettartamukat normál esetben a kopás és a használatból származó sérülések határozzák meg.

A utasítások fordítását a www.protekmedical.com honlapon találja meg.

Bővebb információért vegye fel a kapcsolatot a Protek Medical Products, Inc. vállalattal.

Felelősségi kizárása:

A fenti utasításokat a gyártó orvosi csapatá hagyta jóvá, mint az orvosi eszközök ismétlődő felhasználása előtti előkészítésre alkalmas eljárás. A felhasználó felelőssége az ajánlott feldolgozási módszertől való bármilyen eltérés jóváhagyása, illetve a hatékonyság és a potenciális káros következmények pontos felmérése.





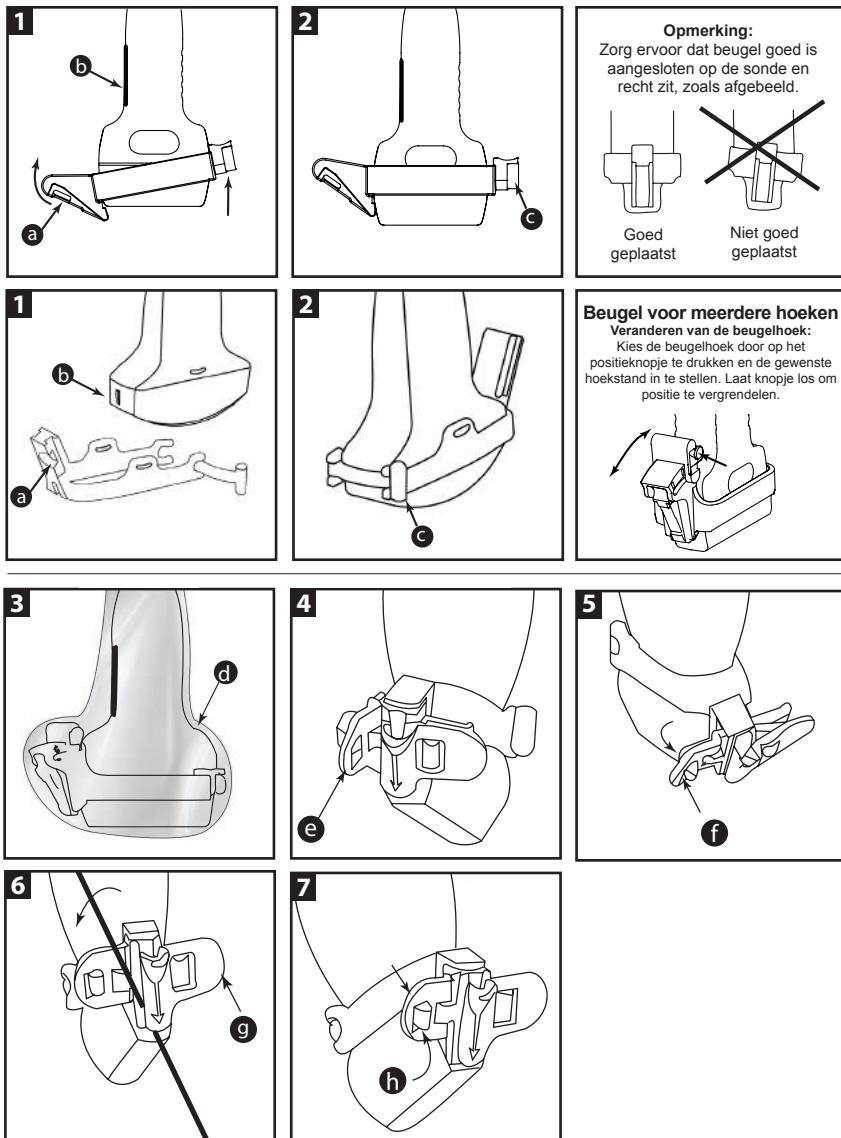
**GEBRUIKSINSTRUCTIES**

Bereid de sonde voor volgens de bedieningshandleiding van het systeem. De herbruikbare beugel wordt niet-steriel geleverd. Controleer bij toepassing van de systeemrichtlijnen de naald altijd volgens de gebruiksaanwijzing.

! Niet gebruiken wanneer de beugel/naaldgeleider niet goed past. Reinig en steriliseer het instrument vóór het eerste gebruik aan de hand van de aanbevolen instructies hieronder. Gebruik de juiste naaldlengte om het beoogde gebied te bereiken.

Biopsie-beugel voor enkele hoek/voor meerdere hoeken (Beugel is herbruikbaar)

- 1 Bevestig de beugel (stijlen variëren) aan de sonde waarbij u de ontvanger vand e naaldgeleider op de beugel (a) uitlijnt met de scanzijde van de sonde (b).
- 2 Zorg ervoor dat de arm vast op de sonde is bevestigd (c).

**Naaldgeleider voor algemene toepassing (eenmalig gebruik)**

- 3 Breng gel aan op de binnenbekleding en/of het scanylak van de sonde. Plaats de sondekap (d) op de sonde met armcombinatie. Zet de kap met strippen vast.
- 4 Plaats de naaldgeleider (e) volgens de afbeelding op de arm terwijl de borggreep omhoog wijst.
- 5 Zet de naaldgeleider vast door de borggreep over de sluitknop (f) omlaag en omhoog te drukken.
- 6 Met een druk op het naaldgeleiderbed (g) kan de naald snel worden vrijgemaakt.
- 7 Trek de borggreep over de sluitknop (h) omhoog en omlaag om de naaldgeleider te verwijderen.

! De naaldgeleider is bestemd voor eenmalig gebruik. **Niet hergebruiken. Niet opnieuw steriliseren. Hergebruik, herverwerking of hersterilisatie van apparaten die voor éénmalig gebruik bestemd zijn kunnen een risico van kruisbesmetting vormen, infectie van de patiënt en/of breken van het apparaat veroorzaken.**

Verwijder na gebruik alle componenten bestemd voor eenmalig gebruik als infectueus afval. Niet gebruiken als de steriele verpakking beschadigd is.

STERILE EO

! Niet hergebruiken.

Herbruikbare instrumenten reinigen, desinfecteren en steriliseren**Reinigen**

Herbruikbare instrumenten moeten grondig worden gereinigd voordat zij aan de sterilisatieprocedure worden onderworpen. Denk eraan dat u alleen door het instrumentarium vooraf de reinigen sterilisatie of verregaande desinfectie kunt bereiken.

- 1 Spoel het vuil van het instrument.
- 2 Bereid de enzymatische oplossing (bijvoorbeeld Enzol) voor volgens de instructies van de fabrikant voor correct verdunnen.
- 3 Dompel het instrument volledig onder in het reinigingsmiddel en laat het 10 minuten lang inweten.
- 4 Borstel het instrument na het inweten grondig schoon met een zachte borstel. Reinig de lumens en holten met behulp van een borstel van het juiste formaat. Een spuit kan worden gebruikt voor het schoonspoelen van moeilijk bereikbare onderdelen van het instrument.
- 5 Spoel het instrument grondig af en droog het. Gebruik altijd via omgekeerde osmose gereinigd water of gedestilleerd water voor het schoonspoelen van het instrument. Bij gebruik van kraanwater kan het behandelde instrument opnieuw worden besmet. Gebruik een schone, zachte doek om het instrument af te drogen.
- 6 Onderzoek grondig alle oppervlakken om er zeker van te zijn dat geen zichtbare bioburden achterblijft. Als er zichtbare vlekken zijn achtergebleven op het instrument, herhaalt u het reinigings- en droogproces totdat het HELE instrument schoon is.

Aanbevelingen voor desinfectie en sterilisatie van herbruikbare instrumenten van kunststof of geanodiseerd aluminium

Doe na reiniging volgens de bovenstaande aanbevelingen als volgt: Week de instrumenten en/of materialen gedurende minimaal 5 minuten in een Enzol enzymatisch reinigingsmiddel met een neutrale pH, zoals geproduceerd door Johnson & Johnson®.

Steriliseer met een geactiveerde Cidex- dialdehyde-oplossing zoals wordt vervaardigd door Johnson & Johnson, of met een equivalente goedgekeurde sterilisatiemethode die wordt gebruikt door de sterilisatieafdeling voor vergelijkbare instrumenten.

Stoomsterilisatie van roestvrijstalen herbruikbare instrumenten

Na de reiniging met behulp van de bovenstaande aanbevelingen, voert u stoomsterilisatie (sterilisatortype – zwaartekraakt) in een autoclaaf op minimaal 132 graden Celsius (270 graden Fahrenheit) gedurende minimaal 15 minuten. Laat het instrument gedurende minimaal 25 minuten drogen.

Bij het steriliseren van meerdere instrumenten tijdens één autoclaafcyclus moet u ervoor zorgen dat de maximale belading van de sterilisator niet wordt overschreden.

Waarschuwing

- Lange smalle kanalen en blinde holten vereisen speciale aandacht tijdens het reinigen.
- Gebruik instrumenten die voor eenmalig gebruik bedoeld zijn nooit opnieuw.
- Verpak en bewaar het instrument na sterilisatie op de goede wijze om te bereiken dat de steriliteit vóór gebruik niet wordt verbroken.
- Gebruik altijd een sondekap om de kans op contaminatie te klein mogelijk te maken.

Inspectie en functietest

Voor een visuele inspectie uit op schade en slijtage. Controleer bij instrumenten met scharnieren of de scharnieren nog soepel beweging zonder buitensporige speling. Vergrendelingsmechanismen moeten worden gecontroleerd op werking.

Beperkingen bij herverwerking


Herhaalde verwerking heeft minimale uitwerking op deze instrumenten. Het einde van de levensduur wordt normaliter bepaald aan de hand van slijtage en schade ten gevolge van gebruik.

Voor vertalingen van deze instructies kunt u terecht op www.protekmedical.com.

Neem voor meer informatie contact op met Protek Medical Products, Inc.

Disclaimer:

De hierboven verstrekte instructies zijn gevalideerd door de fabrikant van medische instrument als mogelijke methoden om een medisch instrument voor te bereiden voor hergebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele afwijkingen van de aanbevolen verwerkingsmethode en mogelijke negatieve gevolgen te kwalificeren.

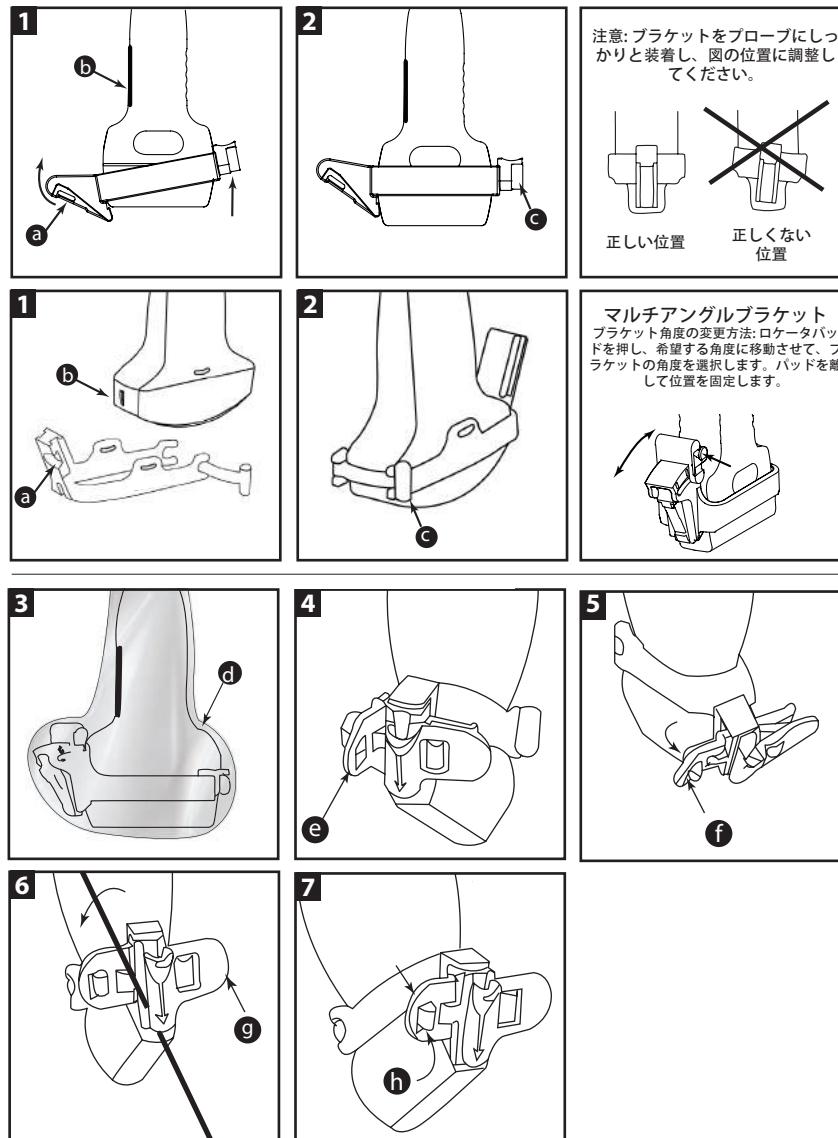

使用方法

使用する機器の操作マニュアルに従ってプローブを準備します。リユース可能型ブラケットには滅菌処理を施していません。使用前に、ニードルの刺入経路が超音波画像診断装置等の画面上のガイドラインと一致していることを常に確認してください。

⚠ ブラケット/ニードルガイドを正しく装着できない場合は使用しないでください。
以下の推奨方法に従い、ご使用前にブラケットの洗浄および滅菌を行ってください。対象エリアに届く適切な長さのニードルを使用してください。

シングルアンダル生検ブラケット/マルチアンダル生検ブラケット(ブラケットはリユース可能型です)

- 1 ブラケットのニードルガイドレーザー (a) とプローブのスキャニングサイド (b) を合わせながら、ブラケット (様式が異なる場合あり) をプローブに装着します。
- 2 ブラケットがプローブにしっかりと取付けられていることを確認します (c)。

使い捨て汎用ニードルガイド

- 3 カバー内か、またはプローブスキャン面上にジェルを付けます。プローブとブラケット上にプローブカバー(d)を取り付けます。カバーをバンド(a)で固定します。
- 4 図のように、ロックパッドを引き上げ、ニードルガイド(e)をプローブカバー/ブラケット上に取り付けます。
- 5 ニードルガイドを正位置に固定するため、ロックパッドを押し下げる同時にロックボタン(f)をロックが完全にかかるまで上げます。
- 6 ニードルを迅速に外すには、ニードルガイドパッド(g)を押します。
- 7 ニードルガイドを取り外すには、ロックパッドを引き上げると同時にロックボタン(h)を下げます。

⚠ 当ニードルガイドは、使い切り型です。再使用しないでください。再び滅菌しないでください。使い捨て医療器具を再使用、再加工または再殺菌することは相互汚染、患者の感染症、さらにこれららの発生の有無を問わず、器具の故障を招くおそれがあります。使用後は感染性廃棄物として廃棄処分してください。滅菌パッケージが破損している場合は使用しないでください。

STERILE EO

② 再使用しないでください。

リユース可能型ブラケットの洗浄、殺菌および滅菌

洗浄

再利用可能な器具は、滅菌プロセスに入る前に、完全に洗浄してください。はじめに器具を洗浄しないと、滅菌または高水準の殺菌ができないことを忘れないでください。

- 1 器具の汚れを洗い流します。
- 2 製造者の希釈方法に関する推奨に従い、酵素溶液 (Enzol (エンゾール) 等) を準備します。
- 3 器具を10分ほど洗浄剤に浸しておきます。
- 4 洗浄剤に浸けたあと、毛先が柔らかいブラシで器具をブラッシングします。適切なサイズのブラシで内腔や穴を洗浄します。届きにくい部分についてはシリングを使って洗い流すこともできます。
- 5 器具を完全に洗い流してから乾かします。器具を洗い流すときは常にR/O (逆浸透) またはDI (イオン除去) 水を使用します。水道水は再処理された器具が再び汚染される原因となる場合があります。器具を乾かすときは柔らかい清潔な布をご利用ください。
- 6 表面をすべて丁寧に見直し、バイオバーデンが残っていないことを確認します。器具に目立つ汚れが付着している場合、完全にきれいになるまで洗浄および乾燥を繰り返します。

プラスチック製または陽極酸化処理済みのアルミニリユース可能型器具の殺菌および滅菌における推奨事項
上記の推奨に従って洗浄した後最低5分間、ジョンソン・&ジョンソン製等の中性酵素エンゾール洗剤に浸けます。滅菌は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社のCidex活性ジアルデヒド溶液を使用するか、または同様の有効な器具洗浄方法で行ってください。

ステンレススチールリユース可能型器具の蒸気滅菌

上記の推奨方法でクリーニングを行った後は、摄氏132度 (華氏270度) 以上のオートクレーブで最低15分は蒸気滅菌してください (滅菌装置タイプ - 重力置換)。器具を25分以上乾燥させます。1回のオートクレーフサイクルで複数の器具を滅菌する場合、滅菌装置の最大容量を超えないように注意してください。

注意

- クリーニングでは長細い捕管および止り穴に注意してください。
- 使い切り型のラベルが付いた装置を再利用または再処理しないでください。
- 滅菌後、再利用の前に無菌性が損なわれないよう器具を適切に梱包して保存してください。
- 汚染を最小限に留めるため、常にプローブを使ってください。

検査および機能テスト

損傷や磨耗がないかどうかを目視検査します。ヒンジ付き器具の場合、過剰な「あそび」がなく、ヒンジがスムーズに動くことを確認します。ロック機構の動作に問題がないことを確認します。











再処理における制限事項

再処理を繰り返すことで器具に生じる影響は微小です。使用にともなって生じる磨耗や損傷から耐用期間を判断してください。

翻訳された説明書をご希望の場合は www.protekmedical.com をご覧ください。
詳細については、Protek Medical Products, Inc.までお問い合わせください。

免責条項:

上記の使用方法は医療機器の製造業者により、再利用可能な医療器具としての有効性が認められたものです。取り扱いにおける推奨方法に従うかどうか、またその有効性や悪影響の可能性の適切な評価については、すべてユーザーの責任となります。

**사용목적:**

초음파 영상진단을 하면서 생검을 하거나 생검침의 정확한 위치를 잡기 위하여 생검침 또는 카테터를 안내하기 위하여 사용합니다.

사용 지침

사용 장비의 조작 매뉴얼에 따라 프로브를 준비하십시오. 재사용 가능형 브래킷 / 니들 가이드는 멀균처리를 하지 않았습니다. 사용 전에 주사침이 가이드라인과 일치하는지 항상 확인하십시오.



브래킷 / 니들 가이드가 올바르게 장착되지 않았을 경우 사용하지 마십시오. 아래 명시된 권장 지침에 따라 사용 전에 브래킷 / 니들 가이드를 세척/멀균하십시오. 대상 부위에 닿는 적절한 길이의 주사침을 사용하십시오.

단일 각도/다중 각도 생검 브래킷 (브래킷은 재사용 가능형)

- 1 브래킷의 니들 가이드 리시버(a)와 프로브의 스캐닝 면(b)을 정렬하여 브래킷(양식이 다를 수 있음)을 프로브에 장착하십시오.
- 2 브래킷 / 니들 가이드가 프로브(c)에 안전하게 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

일회용 일반 용도 니들 가이드

- 3 커버 안쪽 및/또는 프로브의 스캐닝 표면에 젤을 바르십시오. 프로브와 브래킷 어셈블리에 프로브 커버(d)를 씌우십시오. 커버를 밴드로 단단히 고정하십시오.
- 4 그림과 같이 톡킹 패드를 위에 둔 상태에서 니들 가이드(e)를 프로브 커버 위로 마운팅 브래킷에 위치하도록 하십시오.
- 5 톡킹 패드를 아래로 누르는 동시에 톡 버튼(f)을 위로 옮겨 완전히 닫히도록 하면서 니들 가이드를 정위치에 고정하십시오.
- 6 주사침을 신속하게 꺼내려면 니들 가이드 패드(g)를 눌러 가이드로부터 주사침을 제거하십시오.
- 7 사용 후 니들 가이드를 제거하려면 톡킹 패드를 밀어 옮기는 동시에 톡 버튼(h)을 아래로 누르십시오.



본 니들 가이드는 일회용입니다. 재사용하지 마십시오. 재활용하면 교차 오염, 환자 감염 및/또는 해당 일회용기 오작동의 위험을 초래할 수 있습니다.

일회용 부품은 사용 후 감염성 폐기물로서 폐기처분하십시오. 손상된 멀균 패키지는 사용하지 마십시오.

STERILE EO

재사용하지 마십시오.

재사용 가능한형 브래킷의 세척, 살균 및 멀균**세척**

재사용 가능한 기구는 멀균 처리 전에 철저하게 세척해야 합니다. 처음에 기구를 세척하지 않을 경우 멀균 또는 고수준의 살균 효과를 얻을 수 없다는 점을 명심하십시오.

1. 기구에 묻은 젤을 씻으십시오.
2. 적절한 회석 방법에 관한 제조자의 지침에 따라 효소 용액(엔졸 등)을 준비하십시오.
3. 기구를 10분 동안 세제에 담그십시오.
4. 세제에 담근 후 기구를 연한 틸의 솔로 솔질하십시오. 적절한 크기의 솔로 내부 공간 또는 구멍을 청소하십시오. 기구의 도달하기 힘든 부분은 주사기를 사용하여 씻어낼 수 있습니다.
5. 기구를 철저히 씻은 후 건조시키십시오. 항상 역삼투수 또는 탈염수로 기구를 씻으십시오. 수돗물은 재처리된 기구를 다시 오염시킬 수 있습니다. 기구를 건조시키기 위해 청결하고 부드러운 천을 사용하십시오.
6. 바이오버든 잔여물이 남아 있지 않도록 모든 표면을 철저히 검사하십시오. 기구에 눈에 띠는 것이 있을 경우, 기구 전체가 청결해질 때까지 세척 및 건조를 반복하십시오.

플라스틱 또는 양극 산화 알루미늄제 재사용 가능형 기구의 고수준 살균/멀균을 위한 권장 사항

위에 명시한 권장 사항에 따라 세척한 후 최소 5분 동안 존슨앤드존슨©사의 제품과 같은 중성 효소 엔졸 세제에 담그십시오.

존슨앤드존슨©사의 제품과 같은 싸이데스 활성 디알데히드 용액 또는 이에 상응하며 멀균 부서에서 채택한 입증된 기구 멀균 방법으로 멀균하십시오.

스테인레스강제 재사용 가능형 기구의 중기 멀균

위에 명시한 권장 사항에 따라 세척한 후 최소 설피 132도(화씨 270도)의 오토클레이브에서 최소 15분 동안 중기 멀균(멀균기 유형 - 중력 치환)하십시오. 기구를 최소 25분 동안 건조시키십시오. 여러 기구를 오토클레이브에서 1회로 모두 멀균할 때는 멀균기의 최대 용량을 초과하면 안됩니다.

경고

- 세척 중 길고 가는 살관 및 부분 관통 구멍은 특별히 주의하십시오.
- 일회성 레이저를 부착된 기구는 재사용 또는 재처리하지 마십시오.
- 멀균 후에는 기구를 적절히 포장·보관하여 재사용하기 전에 멀균상태가 훼손되지 않도록 하십시오.
- 오염을 최소화하기 위해 항상 프로브 커버를 사용하십시오.

검사 및 기능 테스트

- 손상 및 마모 상태를 눈으로 검사하십시오. 경첩이 달린 기구의 경우, 과도한 "작동"을 삼가면서 경첩의 부드러운 움직임을 점검하십시오.
- 잠금 장치의 작동을 점검해야 합니다.

재처리 관련 제한 사항



재처리를 반복하여도 이러한 기구에 미치는 영향은 최소입니다. 기구의 사용 기한은 통상 사용에 따른 마모 및 손상 상태에 의해 결정됩니다.

본 기구에 대한 번역문은 원하면 www.protekmedical.com를 방문하십시오.

자세한 정보는 Protek Medical Products, Inc.로 문의하십시오.

면책 조항:

의료 기구 제조업체에서 상기 명시된 지침이 재사용 의료 기구에 적용 가능함을 검증했습니다. 권장 처리 방식의 편차를 수정하고 그 효과 및 부정적인 결과의 가능성에 적절히 평가하는 것은 사용자의 책임입니다.

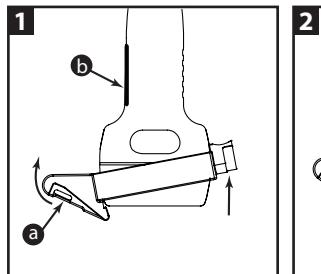



Nota: Certifique-se que o suporte está firmemente encaixado na sonda e está alinhado, conforme apresentado.









Alinhamento correcto



Alinhamento incorrecto



Suporte multi-angular
Modificação do ângulo do suporte:
Selecione o ângulo do suporte, premindo a patilha localizadora e colocando no ângulo desejado. Liberte a patilha para bloquear na posição desejada.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Prepare a sonda de acordo com o manual de operação do sistema. O suporte reutilizável é fornecido não esterilizado. Quando usar as diretrizes do sistema, sempre confirme se a agulha está de acordo com as diretrizes antes de usar.



Não utilize se o suporte/guia da agulha não encaixar adequadamente. Limpe e esterilize antes da primeira utilização, seguindo as instruções de utilização recomendadas abaixo. Utilize o comprimento de agulha adequado para alcançar a área visada.

Suporte para biópsia de ângulo único/biópsia multi-angular (O suporte é reutilizável)

- Anexe o suporte (os estilos podem variar) à sonda que alinha o receptor da guia da agulha no suporte (a) com o lado examinador da sonda (b).
- Assegure-se de que o suporte esteja adequadamente preso à sonda (c).

Guia da agulha para aplicação geral, reutilizável

- Espalhe gel dentro do envoltório e/ou sobre a superfície de leitura. Coloque o envoltório da sonda (d) sobre o conjunto da sonda e suporte. Prenda o envoltório com fitas.
- Coloque a guia da agulha (e) sobre o suporte como mostrado com a trava na posição elevada.
- Trave a guia da agulha na posição pressionando para baixo a trava e para cima o botão da trava (f).
- Para a rápida liberação da agulha, pressione o dispositivo da guia da agulha (g).
- Para remover a guia da agulha, puxe a trava para cima e o botão da trava para baixo (h).




A guia da agulha é para uso único. **Não reutilize. Não esterilize novamente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização de dispositivos de uso único, pode criar riscos de contaminação cruzada, paciente infecionado e/ou mau funcionamento do dispositivo.**

Após a utilização, elimine os componentes descartáveis como resíduos infecciosos. Não utilize se a embalagem esterilizada estiver danificada.

STERILE EO

Non-sterile



Não reutilize.

Limpeza, desinfecção e esterilização dos dispositivos reutilizáveis

Limpeza

Dispositivos reutilizáveis devem ser totalmente limpos antes de passar pelo processo de esterilização. Lembre-se, você só conseguirá total esterilização ou desinfecção de alto nível se o conjunto estiver previamente limpo.

- Lave a sujidade em excesso do dispositivo.
- Prepare a solução enzimática (como Enzol), seguindo as instruções do fabricante para a diluição adequada.
- Submerja totalmente o dispositivo no detergente e deixe-o mergulhado durante 10 minutos.
- Após a submersão, escove exaustivamente o dispositivo com uma escova de cerdas macias. Limpe os lumes e orifícios com uma escova de dimensões adequadas. Pode ser utilizada uma seringa para irrigar as áreas de mais difícil acesso do dispositivo.
- Enxágue e seque bem o dispositivo. Utilize sempre O/I (osmose inversa) ou água DI (desionizada) para enxugar o dispositivo. A água da torneira pode re-contaminar o dispositivo re-processado. Utilize um pano macio e limpo para secar o dispositivo.
- Examine exaustivamente todas as superfícies para se certificar de que não restam quaisquer cargas biológicas. Se quaisquer partes visíveis observadas no dispositivo continuarem sujas, repita a limpeza e seque até TODO o dispositivo estar limpo.

Recomendações para desinfecção e esterilização de dispositivos reutilizáveis de plástico ou alumínio anodizado

Após a limpeza usando as recomendações acima, deixe em imersão por no mínimo 5 minutos em detergente enzimático de pH neutro como o produzido pela Johnson & Johnson®. Esterilize com solução de dialdeído activado Cidex, como a fabricada pela Johnson & Johnson®, ou qualquer outro método equivalente de esterilização validado adoptado pelo departamento de esterilização para dispositivos semelhantes.

Esterilização a vapor de dispositivos reutilizáveis de aço inoxidável

Após a limpeza seguindo as recomendações acima, esterilize a vapor (tipo de esterilizador – gravidade) numa autoclave a um mínimo de 132 graus Celsius (270 graus Fahrenheit) durante um mínimo 15 minutos. Seque o dispositivo durante um mínimo 25 minutos. Ao esterilizar múltiplos instrumentos num ciclo de autoclave, certifique-se de que a carga máxima do esterilizador não é excedida.

Aviso

- É necessário estar particularmente atento às canulações longas e estreitas, e aos orifícios cegos, durante a limpeza.
- Não reutilize ou reprocesse dispositivos rotulados para uso único.
- Após a esterilização, embale e armazene o dispositivo de modo apropriado para assegurar que a esterilização não seja comprometida antes da reutilização.
- Sempre utilize uma cobertura para a sonda para minimizar quaisquer contaminantes.

Inspecção e verificação da função

Verifique visualmente a presença de danos e desgaste. Nos instrumentos articulados, verifique se a articulação se move suavemente sem "folga" excessiva. É necessário verificar a acção dos mecanismos de bloqueio.

Limitações de reprocessamento


O processamento repetido tem um efeito mínimo nestes dispositivos. O fim da vida útil é normalmente determinado pelo desgaste e danos devidos à utilização.

Para obter traduções destas instruções, visite www.protekmedical.com.

Para mais informações, contacte a Protek Medical Products, Inc.

Exclusão de responsabilidade:

As instruções acima fornecidas foram validadas pelo fabricante do dispositivo médico como adequadas para a preparação de um dispositivo médico para reutilização. É da responsabilidade do utilizador qualificar quaisquer desvios do método de processamento recomendado e avaliar adequadamente a eficácia e potenciais consequências adversas.

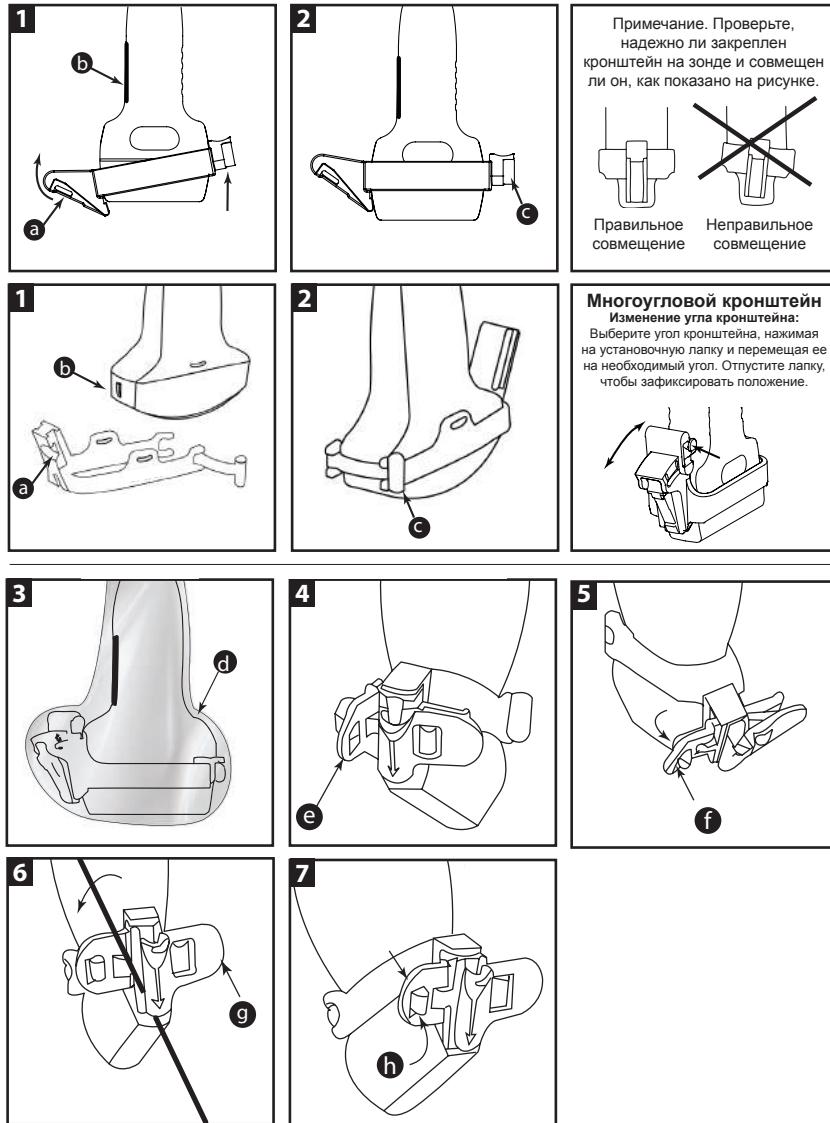

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовить датчик согласно инструкции по эксплуатации системы. Кронштейн многоразового использования поставляется в нестерильном виде. При использовании направляющих для системы, перед применением всегда проверяйте, что игла идет по направляющей.

⚠️ Если кронштейн/направляющий канал для иглы не подходят как следует, не используйте их. Перед первым использованием очистите/простерилизуйте кронштейн в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Чтобы достичь целевого участка, используйте иглу соответствующей длины.

Одноугловый кронштейн для биопсии/Многоугловый кронштейн для биопсии (Кронштейн предназначен для многоразового использования).

- 1 Присоедините кронштейн (стили могут быть различными) к зонду, совместив приемник направляющего канала для иглы на кронштейне (a) со сканирующей стороной зонда (b).
- 2 Убедитесь в том, что держатель надежно прикреплен к датчику (c).

одноразовый направляющий канал для иглы общего назначения

- 3 Нанести гель на внутреннюю поверхность крышки и (или) сканирующую поверхность датчика. Установить крышку датчика (d) на датчик и держатель в сборе. Закрепить крышку с помощью крепежных лент.
- 4 Установить направляющую для иглы (e) на держателе с помощью крепежной прокладки в приподнятом положении, как показано на рисунке.
- 5 Зафиксировать направляющую для иглы в нужном положении нажатием фиксирующей прокладки и переведением фиксирующей кнопки в верхнее положение (f).
- 6 Для быстрого высвобождения иглы нажать прокладку направляющей для иглы (g).
- 7 Для снятия направляющей для иглы вытянуть фиксирующую прокладку и перевести фиксирующую кнопку в нижнее положение (h).

⚠️ Направляющая для иглы предназначена только для однократного применения. **Повторное использование не допускается. Повторная стерилизация не допускается. Повторное использование, повторная обработка или повторная стерилизация одноразового устройства может привести к перекрестному заражению, инфицированию пациента и/или отказу самого устройства.**

После использования утилизируйте одноразовые компоненты как инфицированные отходы. Запрещается использовать, если нарушена стерильная упаковка.

STERILE EO

⚠️ Повторное использование не допускается.

Очистка, дезинфекция и стерилизация средств многоразового использования

Очистка

Перед процессом стерилизации средства многократного применения необходимо тщательно очистить. Следует помнить, что без предварительной очистки добиться высококачественной стерилизации или дезинфекции невозможно.

1. Смойте крупные загрязнения с устройства.
2. Приготовьте ферментный раствор (например, Enzol) в соответствии с указаниями производителя относительно надлежащей концентрации раствора.
3. Полностью погрузите устройство в моющее средство и оставьте на 10 минут.
4. После замачивания тщательно вымойте устройство щеткой с мягкой щетиной. Вымойте просветы и отверстия при помощи щетки соответствующего размера. Для промывки труднодоступных мест устройства может использоваться шприц.
5. Тщательно сполосните и высушите устройство. Всегда используйте воду, очищенную методом обратного осмоса или дезинизации, для промывки устройства, поскольку вода из-под крана может загрязнить очищенное устройство. Высушите устройство мягкой тканью.
6. Тщательно проверьте все поверхности на наличие видимых остатков биологических загрязнений. Если на устройстве есть видимые загрязнения, повторяйте очистку и сушку до тех пор, пока ВСЕ устройство не будет чистым.

Рекомендации по дезинфекции и стерилизации устройств многоразового использования из пластика или анодированного алюминия

После очистки в соответствии с вышеизложенными рекомендациями: Замочить на время не менее 5 минут в ферментном чистящем средстве, например Enzol производства компании Johnson & Johnson®.

Простерилизуйте раствором активированного дигидроцидексида Cidex, например, производства Johnson & Johnson®, или аналогичным утвержденным методом стерилизации, принятым департаментом стерилизации для подобных устройств.

Паровая стерилизация устройств многоразового использования из нержавеющей стали

После очистки в соответствии с вышеизложенными рекомендациями простерилизуйте устройство паром (тип стерилизатора – гравитационный) в автоклаве при мин. 132 градусах Цельсия (270 градусов по Фаренгейту) в течение минимум 15 минут. Сушите устройство как минимум 25 минут. При стерилизации нескольких инструментов в одном цикле автоклава убедитесь, что максимальная нагрузка стерилизатора не превышается.

Внимание!

- Длинные узкие канюляции и несквозные отверстия требуют особого внимания при очистке.
- Не использовать и не обрабатывать устройства, предназначенные для однократного применения.
- После стерилизации устройство упаковать и поместить на хранение надлежащим образом с целью предотвращения нарушения стерильности перед повторным применением.
- С целью минимизации загрязнения всегда пользоваться крышкой датчика.

Проверка и испытания функционирования

Визуально проверьте устройство на наличие повреждений или износа. В случае поворотных устройств убедитесь в плавности движения и отсутствии чрезмерного люфта. Проверьте действие запорных механизмов.


Ограничения повторной обработки

Повторная обработка оказывает минимальное влияние на эти устройства. Окончание срока службы обычно обусловлено износом или повреждениями при использовании.

Перевод этих инструкций предоставлен на сайте www.protekmedical.com.
более подробной информацией обращайтесь в компанию Protek Medical Products, Inc.

Правовая оговорка

Приведенные выше инструкции были одобрены производителем медицинских устройств как надлежащие процедуры для подготовки медицинского устройства к использованию. Ответственностью пользователя является оценка любых отклонений от рекомендованного метода обработки и надлежащая оценка эффективности и возможных неблагоприятных последствий.

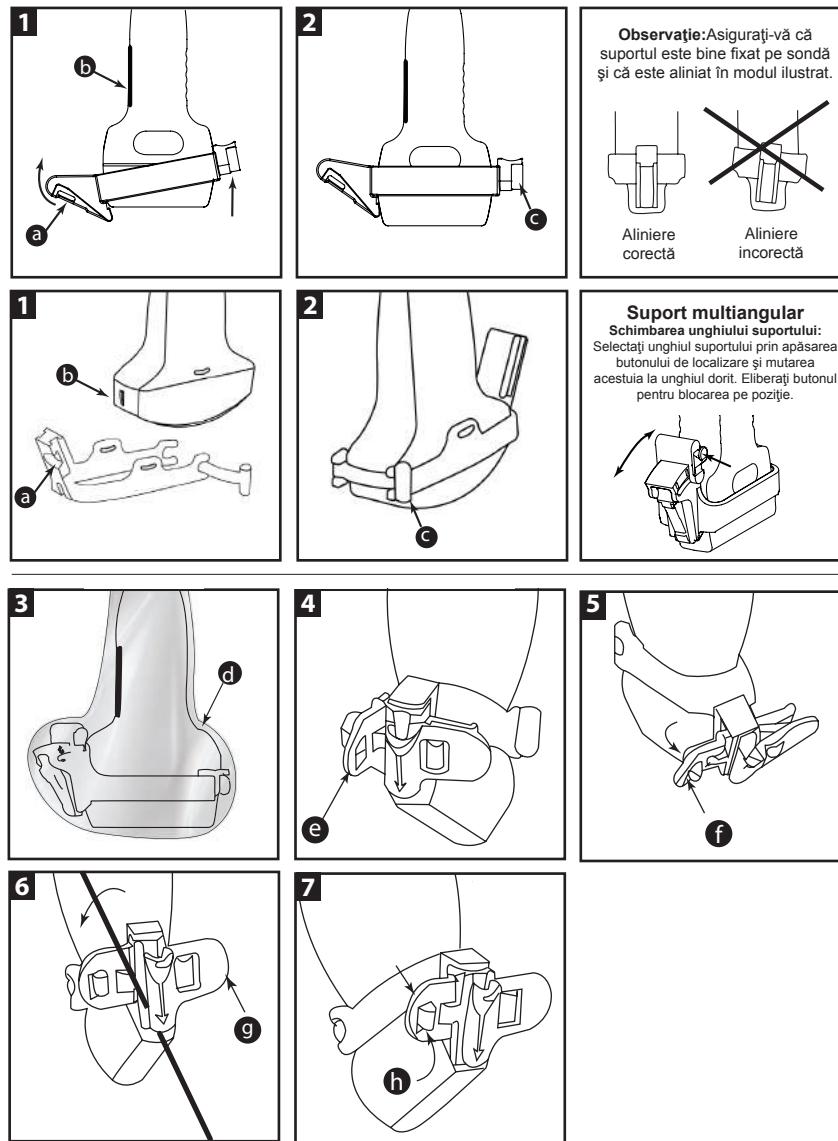**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pregătiți sonda conform manualului de operare a sistemului. Suportul reutilizabil este furnizat nesteril. Întotdeauna înainte de folosire, verificați dacă acul respectă liniile de ghidare ale sistemului.

Avertizare
Dacă suportul/ghidajul de ac nu se potrivește în mod corespunzător, nu se va folosi.
Curătați/steriliizați suportul înainte de utilizare, conform instrucțiunilor recomandate de mai jos. Folosiți un ac de lungime adecvată pentru a ajunge la zona vizată.

Suport pentru biopsie monoangular/multiangular (Suportul este reutilizabil)

- 1 Ataşați suportul (stilurile pot fi diferite) la sondă, aliniind receptorul ghidajului de ac pe suport (a) cu partea de scanare a sondei (b).
- 2 Asigurați-vă că suportul este bine fixat pe sondă (c).

Ghidaj de ac de unică folosință pentru uz general

- 3 Aplicați gel înăuntru acoperitoarea sterile și/sau pe suprafața de scanare a sondei. Așezați acoperitoarea (d) peste ansamblu sonda și suport. Asigurați acoperitoarea cu elastice.
- 4 Plasați ghidul pentru ac (e) pe receptorul de pe suport, după indicații, cu dispozitivul de închidere ridicat.
- 5 Prindeți ghidul pentru ac în poziția corectă apăsând dispozitivul de închidere în jos și butonul de închuire (lock) (f) în sus.
- 6 Pentru a elibera acul rapid, apăsați butonul de pe ghidul pentru ac (g).
- 7 Pentru a desprinde ghidul pentru ac, apăsați dispozitivul de închidere în sus și butonul de închuire (lock)(h) în jos .

! Ghidul pentru ac e de unică folosință. A nu se refolosi. A nu se resteriliza. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea dispozitivelor de unică folosință poate produce riscul de contaminare încrucisată, infectare a pacientului și/sau funcționare defectuoasă a dispozitivului.
Dupa utilizare, eliminați componente de unică folosință ca deșeuri infecțioase. Nu utilizați dacă ambalajul steril este deteriorat.

STERILE EO**2 A nu se refolosi.****Curățarea, dezinfecția și sterilizarea dispozitivelor reutilizabile****Curățarea**

Dispozitivele reutilizabile trebuie să fie curățate cu atenție înainte de a fi supuse procesului de sterilizare. Nu uitati, sterilizarea sau dezinfecțarea în profunzime nu poate fi obținută decât dacă se curăță ansamblul mai întâi.

1. Curătați excesul de murdărie de pe dispozitiv.
2. Pregătiți soluția enzimatică (precum Enzol), urmând instrucțiunile producătorului referitoare la diluarea corectă.
3. Scufundați complet dispozitivul în detergent și țineți-l scufundat timp de 10 minute.
4. După înmuieră, periați bine dispozitivul folosind o perie moale cu păr de porc. Curătați lumenele și orificiile folosind o perie de dimensiuni adecvătă. S-ar putea folosi o seringă pentru a curăta zonele greu accesibile ale dispozitivului.
5. Clătiți bine, apoi uscați dispozitivul. Folosiți întotdeauna apă purificată prin osmoză inversă sau deionizată pentru a clăti dispozitivul. Apa de la robinet ar putea contamina din nou dispozitivul reprelucrat. Utilizați o cărpă curată și moale pentru a usca dispozitivul.
6. Examinați cu atenție toate suprafețele, pentru a vă asigura că nu rămâne o biosarcină vizibilă. Dacă sunt observate parti vizibile pe dispozitiv, repetați curățarea și uscarea până când ÎNTRREGUL dispozitiv este curat.

Recomandări privind dezinfecțarea și sterilizarea dispozitivelor reutilizabile din plastic sau aluminiu anodizat

După curățarea conform recomandărilor de mai sus, mutați dispozitivele timp de cel puțin 5 minute într-un detergent cu pH neutru, enzimatic, ca cele fabricate de Johnson & Johnson®.

Steriliizați cu soluție dialdehidă activată Cidex precum cea produsă de Johnson & Johnson®, sau orice metodă echivalentă de sterilizare aprobată de către departamentul de sterilizare pentru asemenea dispozitive.

Sterilizare cu abur a dispozitivelor reutilizabile din oțel inoxidabil

După curățarea pe baza recomandărilor de mai sus, sterilizați cu abur (tip sterilizator – gravitațional) în autoclavă la cel puțin 132 de grade Celsius (270 de grade Fahrenheit) pentru cel puțin 15 minute. Uscați dispozitivul timp de cel puțin 25 de minute. Când sterilizați mai multe instrumente într-un singur ciclu de autoclavă, asigurați-vă că nu este depășită sarcina maximă a sterilizatorului.

Avertizare

- Canulările lungi și înguste și găuriile oarbe necesită o atenție deosebită în timpul curățării.
- Nu refolosiți sau dezinfecțați dispozitivele ale căror etichete indică faptul că sunt de unică folosință.
- După sterilizare, împachetați și stocați dispozitivul în mod adecvat, pentru a vă asigura că sterilitatea sa nu este compromisă înainte de a fi refolositi.
- Folosiți întotdeauna o teacă pentru probă pentru a reduce riscul de contaminare.

Verificarea și testarea funcțională

Verificați vizual dacă există urme de deteriorare și uzură. Pentru instrumentele articulate, verificați mișcarea lină a articulației, fără să existe un „joc” excesiv. Trebuie verificată funcționarea mecanismelor de blocare.

Limitările la reprelucrare


Prelucrarea repetată are efecte minime asupra acestor dispozitive. Sfârșitul duratei de viață este determinat în mod normal prin uzura și deteriorarea rezultate în urma utilizării.

Pentru traduceri ale acestor instrucțiuni, vizitați www.protekmedical.com.

Pentru mai multe informații, contactați Protek Medical Products, Inc.

Precizări legale:

Instrucțiunile furnizate mai sus au fost validate de producătorul dispozitivului medical, ca fiind adecvate pentru pregătirea unui dispozitiv medical în vederea reutilizării. Este responsabilitatea utilizatorului să aprobe orice abatere de la metoda de prelucrare recomandată și să evaluateze în mod corect eficiența și potențialele efecte adverse.

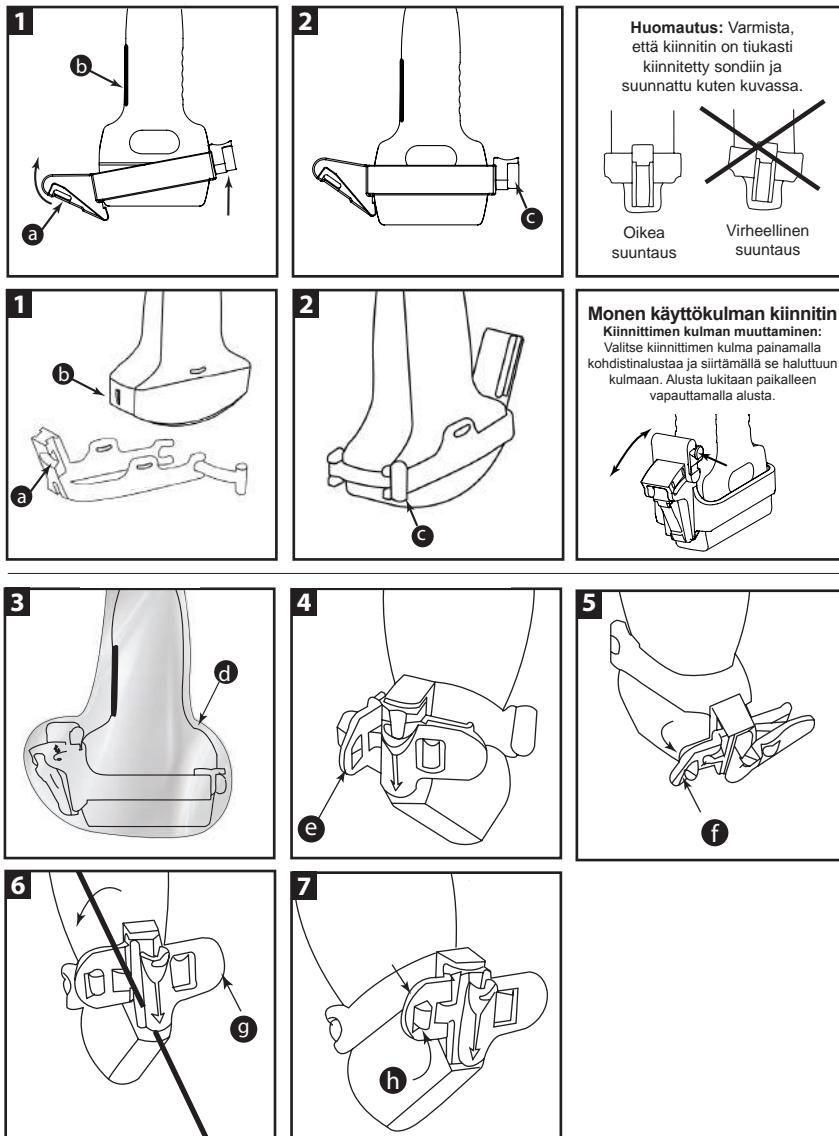**KÄYTÖÖHJEET**

Valmistele anturi noudattaen järjestelmän käyttöoppaan ohjeita. Uudelleenkäytettävä kiinnitin toimitetaan epästeriilinä. Käytäessäsi järjestelmähjaimia tarkista aina ennen käyttöä, että neula seuraa ohjainta.

! Ei saa käyttää, jos kiinnitin/neulanohjin ei sovi paikalleen oikein. Puhdista/steriloii kiinnitin ennen käyttöä alla olevien ohjeiden mukaan. Käytä sopivan pituista neulaa koheadealueen saavuttamiseksi.

Yhden/Monen käyttökulman biopsiakiinnitin (Kiinnitin on uudelleenkäytettävä)

- 1 Yhdistä kiinnitin (tyylejä on erilaisia) sondiin ja aseta samalla kiinnittimen kohta, johon neulanohjin asetetaan (a), samansuuntaisesti sondin tutkimuspulon (b) kanssa.
- 2 Varmista, että teline on tukevasti kiinni anturissa (c).

kertakäytöinen yleiskäyttöinen neulanohjin

- 3 Aseta geeliä kannen sisäpuolelle ja/tai anturin skannauspintaan. Aseta anturin suojuks (d) anturin ja telineyhdistelmän päälle. Kiinnitä kansi nauhoilla.
- 4 Aseta neulanohjin (e) telineeseen kuvaan osoittamalla tavalla lukituslevy yläasennossa.
- 5 Lukitse neulanohjin paikalleen painamalla lukituslevyä alas ja sitten ylös lukitusnappulaan (f).
- 6 Neulan voi vapauttaa nopeasti painamalla neulanohjaimen levyä (g).
- 7 Poista neulanohjin vetämällä lukituslevy alas lukitusnappulasta (h).

! Neulanohjin on tarkoitettu vain kertakäytöön. **Ei saa käyttää uudelleen. Ei saa steriloida uudelleen. Kertakäytölaitteen uudelleenkäyttö, uudelleenkäsittely tai uudelleensterilointi voi aiheuttaa saastumisen, potilasinfektion tai laitteenvikatoiminnan.**

Hävitä kertakäytöiset osat käytön jälkeen tartuntavaarallisena jätteenä. Ei saa käyttää, jos steriliipakkaus on vahingoittunut.

STERILE EO

! Ei saa käyttää uudelleen.

Uudelleenkäytettävien laitteiden puhdistus, desinfiointi ja steriloointi**Puhdistus**

Kestäkäytöiset laitteet täytyy puhdistaa perusteellisesti ennen steriloointia. Muista, että steriloointi tai tehokas desinfiointi eivät omissi, ellei kokoonpano ole ensin puhdistettu.

1. Huuhtele laitteesta irtoava lika.
2. Valmista entsyymiliuos (kuten Enzol). Noudata valmistajan laimennusohjeita.
3. Upota laite kokonaan detergenttiin ja anna sen liota 10 minuuttia.
4. Liutokseen jälkeen harja laite huolellisesti pehmeähajaraksisella harjalla. Puhdista onkalot ja reiät sopivankokoisella harjalla. Vaikasti tavoitettavat laitteet kohdat voidaan huuhdella ruiskun avulla.
5. Huuhtele ja kuivaa laite huolellisesti. Käytä aina R/O- (käänteisosmoosi-) tai DI- (deionisoitua) vettä laitteen huuhteluun. Vesijohovesi voi kontaminoida puhdistetun laitteen. Käytä puhdasta pehmeää liinaa laitteen kuivaamiseen.
6. Tarkasta huolellisesti kaikki pinnat varmistaaksesi, ettei niissä ole jäljellä näkyvää bioainesta. Jos laitteessa on näkyvää ainesta, toista puhdistus ja kuivaa kunnes KOKO laite on puhdas.

Muovista tai anodisoidusta alumiinista valmistetut laitteiden desinfointi- ja steriloointisuositusia
Puhdistukseen jälkeen edellä annetuista suositusten mukaisesti, soak Lioata vähintään 5 minuuttia neutraalini pH:n omaavassa entsymaattisessa puhdistusaineessa käyttäen esimerkiksi Johnson & Johnsonin Entzol-valmistetta. Steriloii Johnson & Johnsonin Cidex aktiviroduilla dialdehydiiliuoksella tai sitä vastaavalla vahvistetulla steriloointimenetelmällä, jonka sterilointiosasto on ottanut käyttöön kyseisenkaltaisille laitteille.

Ruoostumattomasta teräksestä valmistettujen uudelleenkäytettävien laitteiden höyrysterlointi

Puhdistettu laite yllä olevien suositusten mukaisesti höyrysterloil (sterilaattorin tyyppi – painovoima) autoklaavissa vähintään 132 °C:ssä (270 °F:ssä) vähintään 15 minuutin ajan. Kuivata läitetta vähintään 25 minuutin ajan. Kun steriloit useita instrumentteja samassa autoklaavissa, pidä huoli siitä, että steriloointilaitteet maksimikormitusta ei ylietä.

Varoitus

- Pitkä kapeat ontelot ja umpiperäiset kolot vaativat erityishuomiota puhdistuksen aikana.
- Älä käytä uudelleen tai kierrätkää kertakäytöissä merkityjä laitteita.
- Kun laite on steriloitu, pakkaa ja säilytä laite sitten, ettei steriloointi pilaa ennen uutta käyttöä.
- Käytä aina anturin suojusta kontaminointimisen minimoimiseksi.

Tarkistus ja toimintatestaus

Tarkista näönvaraisesti, onko laite vahingoittunut tai kulunut. Jos instrumentissa on saranat, tarkista, että ne kääntyvät helposti vaatimatta liikaa "suostuttelia". Myös lukkomekanismien toiminta tulee tarkistaa.

Toistuvan prosessoinnin rajoitukset


Toistuvalla prosessoinnilla on nähin laitteisiin minimaaliset vaikutukset. Käytöön määritä normaalisti käytöstä aiheutuva kulutus ja vahingoittuminen.

Katso näiden ohjeiden käännyksiä verkkosivulta www.protekmedical.com.

Lisätietoja saat Protek Medical Products, Inc.:ltä.

Vastuuvalapulauske:

Lääketieteellisten laitteiden valmistaja on vahvistanut yllä olevien ohjeiden sopivan lääketieteellisen laitteen valmistamiseksi uudelleenkäytöö varten. Käytäjän vastuulla on arvioida kaikki poikkeamat suosittelusta prosessointimenetelmästä ja tehdä asianmukaiset arvion niiden tehokkuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista.

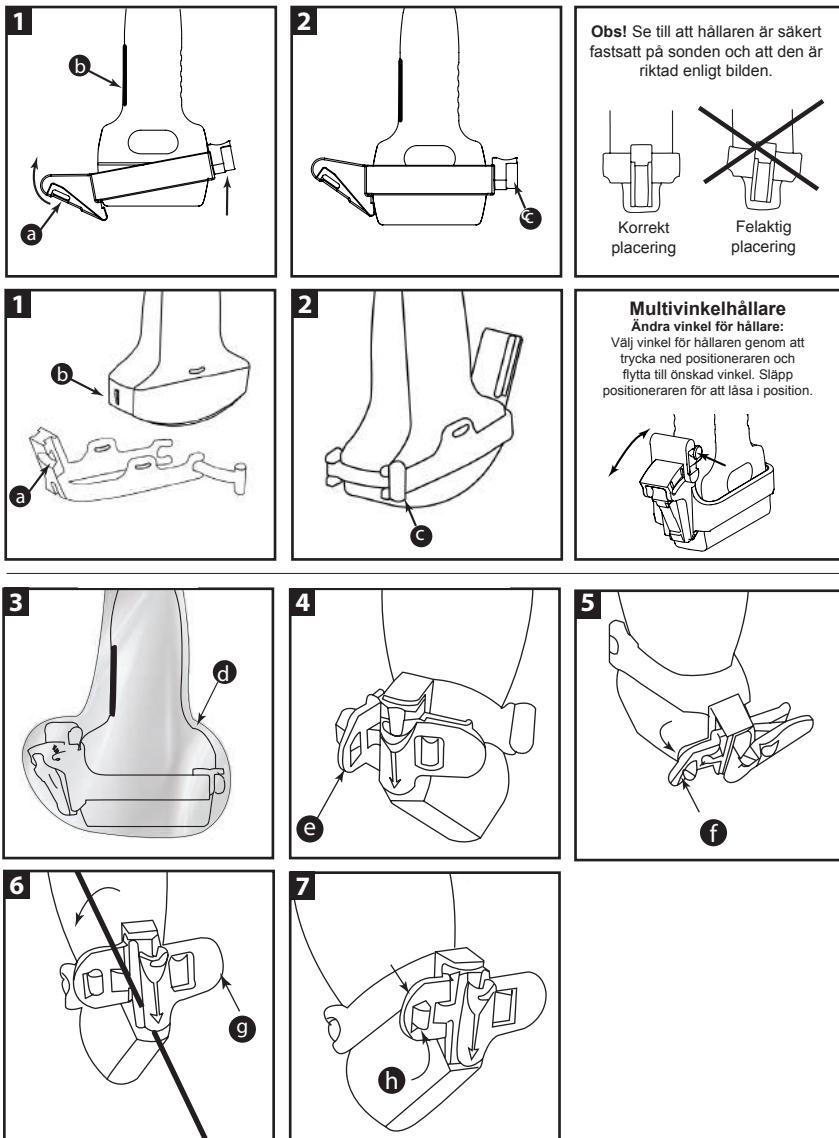**BRUKSANVISNING**

Förbered proben enligt systemets bruksanvisning. Återanvändbar hållare medlevereras icke-steril. Vid användning av systemets riktlinjer skall du alltid verifiera att nälen följer riktlinjen före användning.

⚠️ Om hållaren/nålledaren inte passar ordentligt, använd den inte. Rengör/Sterilisera hållaren före användning enligt de rekommenderade anvisningarna nedan. Använd lämplig nällångd för att nå målområdet.

Envinklad biopsihållare/Multivinkelbiopsihållare (Hållaren är återanvändbar)

- 1 Fäst hållaren (utföranden varierar) till sonden och rätta in näldedarens mottagare på hållaren (a) efter sondens skanningsida (b).
- 2 Säkerställ att hållaren är säkert fäst vid proben (c).

Nålledare för engångsbruk i allmänt syfte

- 3 Lägg gel inuti höljet och/eller på probens scanningsyta. Placera probhöljet (d) över proben och hållaraggregatet. Säkra höljet med banden.
- 4 Placera nålguiden (e) på hållaren såsom visas med läsdynan i förhöjt läge.
- 5 Lås nålguiden i läge genom att trycka ned läsdynan och dra låsknappen uppåt (f).
- 6 För snabb frikoppling av nälen, tryck på nålguidens dyna (g).
- 7 För att avlägsna nålguiden skall du dra läsdynan uppåt och trycka ned låsknappen (h).

⚠️ Nålguiden är endast avsedd för engångsbruk. **Återanvänd inte. Återsterilisera ej. Att återanvända, upparbeta eller sterilisera engångsartiklar på nytt kan medföra risk för korskontaminering, infektion hos patienten och/eller fel på enheten.**

Efter användning, kassera engångskomponenter som smittsamt avfall. Använd ej om den sterila förpackningen är skadad.

STERILE EO

Återanvänd inte.

Rengöring, desinficering och sterilisering av återanvändbara enheter**Rengöring**

Återanvändbara produkter måste rengöras noggrant innan de utsätts för steriliseringssprocessen. Observera att du inte kan uppnå sterilisering eller desinfektion av hög grad om aggregatet inte rengörs först.

- 1 Skölj bort smuts från enheten.
- 2 Förbered den enzymatiska lösningen (som Enzol) genom att följa tillverkarens anvisningar för korrekt utspädning.
- 3 Sänk ner enheten helt i rengöringsmedlet och låt ligga i blöt 10 minuter.
- 4 Borsta av enheten noggrant med en mjuk tagelborste efter blötningen. Rengör hålrum och hål med en borste av lämplig storlek. En spruta kan användas för att spola rent svåråtkomliga ställen på enheten.
- 5 Skölj och torka enheten väl. Använd alltid RO (omvänt osmos) eller DI-vatten (avjoniserat vatten) för att spola ren enheten. Kranvattnet kan kontaminerera den återanvända enheten. Använd en ren mjuk trasa för att torka av enheten.
- 6 Undersök alla ytor noggrant för att försäkra att ingen synlig biofilm finns kvar. Om biologiska rester fortfarande syns på enheten, gör rent och torka på nytt tills hela enheten är rengjord.

Rekommendationer vid desinficering och sterilisering av återanvändbara enheter av plast eller anodiserat aluminium Efter rengöring med användning av de ovan nämnda rekommendationerna. Blötlägg i minst 5 minuter i Enzol enzymatiskt rengöringsmedel med neutralt pH, såsom det som tillverkas av Johnson & Johnson®. Sterilisera med Cidex Activated Dialdehyde-lösning som t.ex. görs av Johnson & Johnson eller använd en likvärdig godkänd steriliseringssmetod som valts av steriliseringssavdelningen för liknande enheter.

Ångsterilisering av återanvändbara enheter av rostfritt stål

Efter rengöring enligt ovanstående rekommendationer, ångsterilisera (typ av steriliseringssapparat - självtryck) i en autoklav vid minst 132 grader Celsius (270 grader Fahrenheit) i minst 15 minuter. Låt enheten torka i minst 25 minuter. Se till att steriliseringssapparaten maxmällast inte överskrider vid sterilisering av flera instrument under en autoklavyckel.

Varng

- Långa smala kanylhål och osynliga hål kräver speciell uppmärksamhet under rengöring.
- Återanvänd eller omarbeta inte produkterna som märkts för engångsbruk.
- Efter sterilisering skall produkten f örpakas och förvaras på lämpligt sätt för att tillförsäkra att steriliteten inte äventyras före återanvändning.
- Använd alltid ett probhölje för att minimera eventuella kontaminanter.

Inspektion och funktionstestning

Okulärbesiktiga för skador och slitage. För ledade instrument, kontrollera för jämn rörelse i led och utan överdrivet "spel". Kontrollera läsmekanismers funktion.

Begränsningar vid återanvändning


Upprepad återanvändning påverkar dessa enheter minimalt. Livslängden bestäms normalt av slitage och skador uppkomna genom användning.

För översättningar av dessa anvisningar, gå till www.protekmedical.com.

Kontakta Protek Medical Products, Inc. för mer information.

Friskrinningsklausul:

Anvisningarna som givits ovan har godkänts av tillverkaren av den medicintekniska produkten och ska vara tillräckliga för att förbereda en medicinteknisk produkt för återanvändning. Det är användarens ansvar att berätta varje avvikelse från rekommenderad föraringsmetod och på ett lämpligt sätt utvärdera dess effektivitet och möjliga negativa följer.

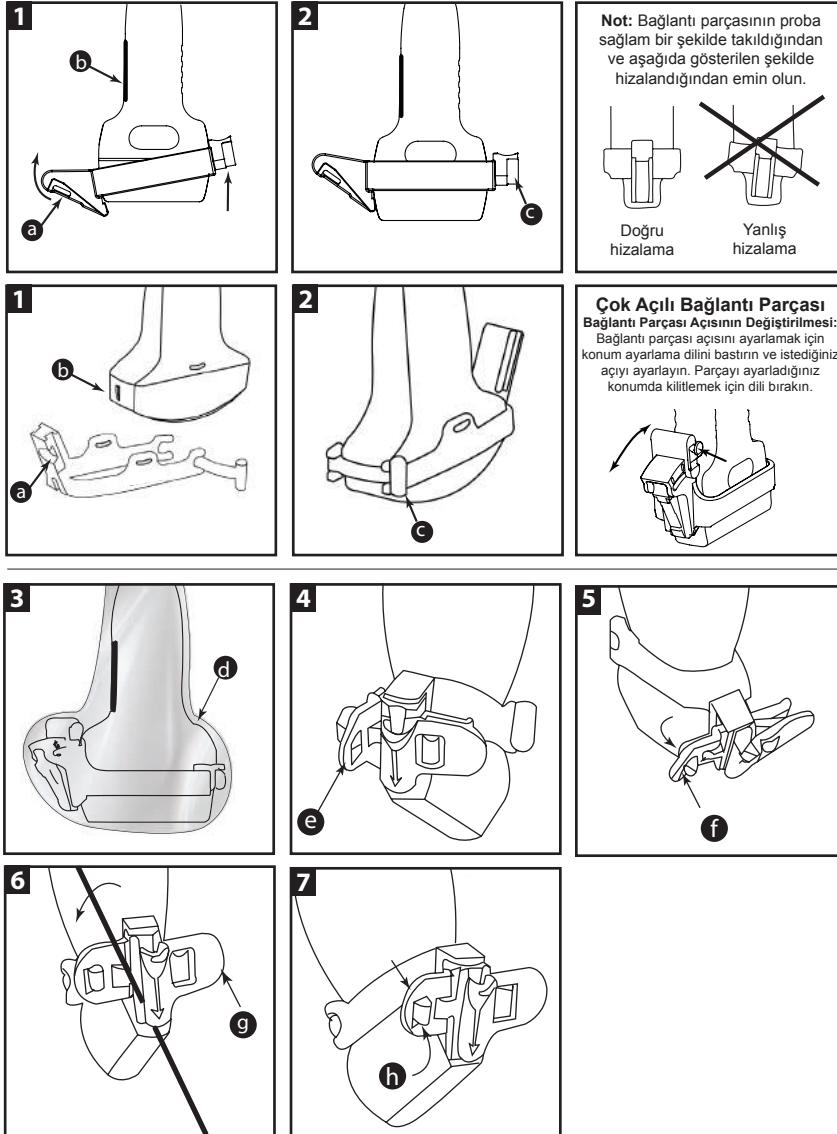

KULLANIM TALİMATLARI

Probu sistemin çalışma el kitabına göre hazırlayın. Tekrar kullanabilir bağlantı parçası sterilize edilmeden sunulmaktadır. Sistem kılavuz ilkelerini kullanırken kullanımından önce daima iğnenin kılavuz ilkelerine uygun olduğundan emin olun.

! Bağlantı parçası/iğne kılavuzunun düzgün oturmaması halinde bu parçayı kullanmayın. İlk kez kullanmadan önce aşağıda önerilen talimatlar doğrultusunda temizleyin/sterilize edin. Hedef alana ulaşmak için uygun uzunluğa sahip iğne kullanın.

Tek Açılı/Çok Açılı Biyopsi Bağlantı Parçası (Bağlantı parçası tekrar kullanılabilir)

- 1 Braketi (şekilleri değişik olabilir) braket üzerinde bulunan mil hizalama iğne kılavuz alıcısına (a) milin tarayıcı tarafı ile takın (b).
- 2 Dirseğin proba sıkıca takıldığından emin olun (c).

Tek Kullanımlık Genel Amaçlı İğne Kılavuzu

- 3 Kapak içine ve/veya prob tarama yüzeyine jel koyun. Prob kapağını (d) prob ve dirsek tertibatı üzerine koyun. Kapağı bantlarla sabitleyin.
- 4 İğne kılavuzunu (e) dirseğe gösterildiği gibi kilitleme pedi yükseltilmiş konumda koyun.
- 5 İğne kılavuzunu kilitleme pedini aşağı itip kilitleme düğmesini yukarı iterek kilitleyin (f).
- 6 İğneyi hızlı bir şekilde serbest bırakmak için iğne kılavuzu pedine basın (g).
- 7 İğne kılavuzunu çıkarmak için kilitleme pedini yukarı ve kilitleme düğmesini aşağı çekin (h).

İğne kılavuzu tek kullanımlıktır. **Tekrar kullanmayın. Tek kullanımlık cihazların yeniden kullanımı, yeniden işlenmesi, veya yeniden sterilizasyonu, capraz bulaşma, hasta enfeksiyonu, ve / veya cihazın ariza riskini artırabilir.** Tek kullanımlık bileşenleri kullandiktan sonra enfeksiyöz atık olarak imha edin. Steril paket hasarlıya kullanmayın.

STERILE EO

(2) Tekrar kullanmayın.

Yeniden Kullanılabilir Aygıtların Temizlenmesi, Dezenfekte ve Sterilize Edilmesi

Temizlik

Tekrar kullanılabilir cihazların sterilizasyon işleminden geçmeden önce iyice temizlenmeleri gereklidir. Tertibat önceden temizlenmeden sterilizasyon veya üst düzey dezenfeksiyon elde edemeyeceğinizi unutmayın.

1. Aygit üzerinde fazla kiri akıtm.
2. Enzimatik çözeltiyi (Enzol gibi), üretici firma talimatlarına uygun olarak seyretlin.
3. Aygitı temizleme maddesi içinde tamamı ile girecek şekilde yerleştirin ve 10 dakika içinde bırakın.
4. Bu işlemden sonra aygitin her yerini yumusak bir fırça ile fırçalayın. Lümen ve delikleri uygun boyutta bir fırça ile temizleyin. Aygitin zor erişilen yerlerini temizlemek için bir şırınga sunulabilir.
5. Aygitı iyicek duruluyken ve kuruluyken. Aygit durulamak için her zaman R/O (ters ozmos) veya DI (de-ionize) su kullanın; musluk suyu temizlenmiş aygitin tekrar kirlemeşmesine neden olabilir. Aygit kurulamak için temiz yumusak bir bez kullanın.
6. Tüm yüzeyleri iyice kontrol ederek üzerinde gözle görülen canlı organizma yükü olmadığından emin olun. Aygit üzerinde gözle görülebilir parçalar bulunuyorsa yıkama ve kuruluma aygitin TAMAMI temizleninceye kadar devam edin.

Plastik veya Eloksal Alüminyum Yeniden Kullanılabilir Aygıtların Dezenfeksiyonu ve Sterilizasyonu İçin Öneriler

Yukarıdaki önerilere göre temizledikten sonra, Johnson & Johnson'ın ürettiği Enzol Enzimatik deterjan gibi nötr pH değerine sahip bir solüsyonda en az 5 dakika bırakın. Sterilizasyon işlemi Johnson & Johnson tarafından üretilen Cidex Aktif Hale Getirilmiş Diyalahid Gözeltisi ile, veya sterilizasyon bölümünde benzer aygıtlar için benimsenmiş ve eşdeğeri doğrulanmış bir sterilizasyon yöntemi ile gerçekleştirin.

Paslanmaz Çelik Yeniden Kullanılabilir Aygıtların Buhar ile Sterilizasyonu

Yukarıda yer alan öneriler doğrultusunda temizlik işlemi yapıldıktan sonra otoklav içinde ve 132 Santigrat derecede en az 15 dakika buhar sterilizasyonu (Sterilizatör türü – yer çekimi) uygulayın. Aygit en az 25 dakika kurutun. Birde fazla enstrümanı tek bir otoklav döngüsü içinde sterilize ederken sterilize cihazının maksimum yükünün aşılmasıından emin olun.

Uyarı

- Temizleme işleminde, ince uzun kanülasyonlar ile kör deliklerin temizlenmesi özel dikkat gerektirir.
- Tek kullanımlık olarak etiketlenmiş cihazları tekrar kullanmayın ve tekrar işleme koymayın.
- Sterilizasyondan sonra, sterilitenin tekrar kullanıldından önce bozulmayacağından emin olmak için cihazı uygun şekilde ambalajlayın ve saklayın.
- Kontaminanları en azındırık için daima prob kapağı kullanın.

Denetleme ve İşlevsellik Testi

Hasar veya yıprama için göz muayenesi yapın. Hareketli parçaların kolay hareket edilebilirliğini bu parçalarla fazla "oynamadan" kontrol edin. Kilitleme mekanizması işlevsellik açısından kontrol edilmelidir.

Yeniden işleme almada sınırlandırmalar


Devamlı kullanımın bu aygıtlar üzerinde minimal etkisi bulunmaktadır. Kullanım süresinin sonu, kullanım nedeni ile eskime ve hasar ile belirlenir.

Bu talimatları çevirileri için www.protekmedical.com adresine gidin.

Daha fazla bilgi için Protek Medical Products, Inc. ile temasla geçin.

Feragatname:

Yukarıda sunulan talimatlar, tıbbi aygıtları yeniden kullanım için hazırlayan ehliyetli üretici tarafından doğrulanmıştır. Önerilen işlem yönteminden farklı uygulamaların kullanılmasının yeterli olduğunu ve bu yöntemin etkinliğinin veya potansiyel elverişsiz sonuçlarının ortaya kommaya kullanımın sorumluluğundadır.

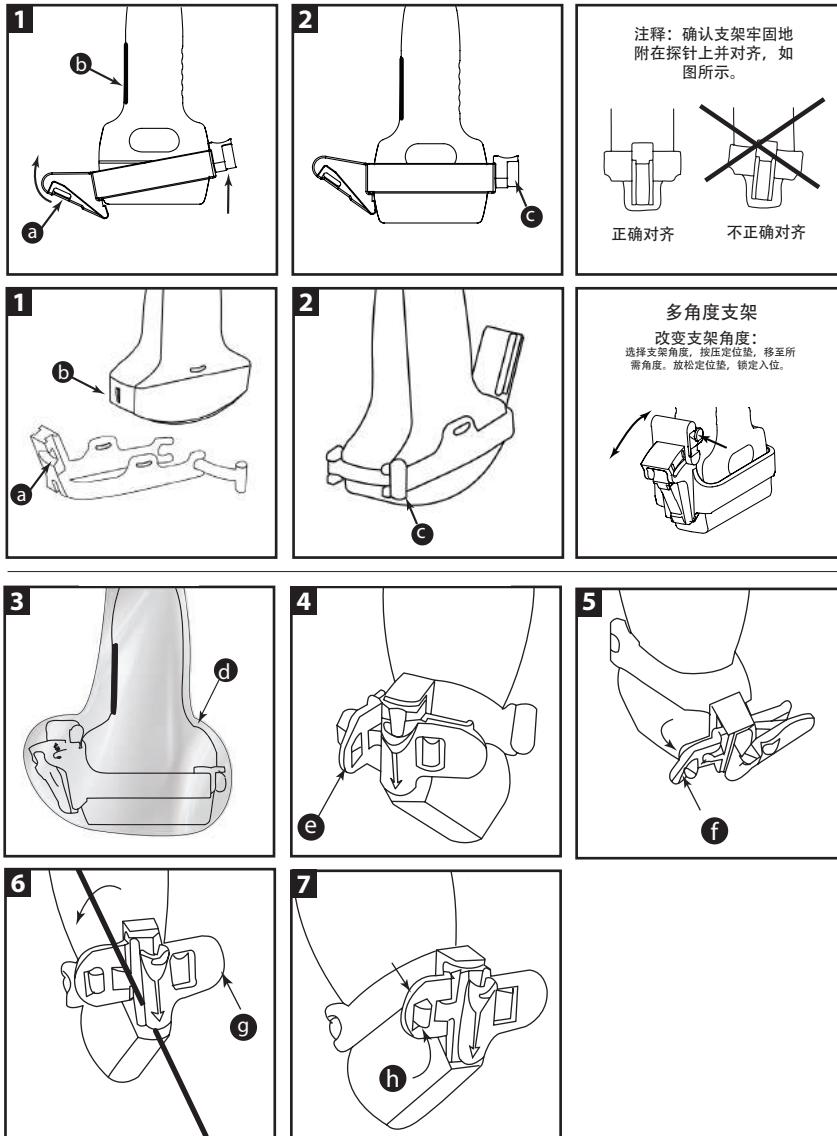


使用说明

根据系统的操作手册准备探头。托架包装时未经灭菌，可多次使用。注：参考系统指南，使用前必须确保按指南处理了针头。

! 如果支架/针导子不配套，不要使用。使用前，应按照以下建议说明进行清洁及消毒。使用适当的长度，让针头到达靶区。

单角度活检支架/多角度活检支架（支架可重复使用）

- 1 将支架（类型各异）连接到位于(a)带有探针扫描面(b)的支架上的探针校准针导子接收器上。
- 2 确保托架牢牢固定在探头上(c)。



一次性通用针导子

- 3 在盖的内壁和/或探头扫描面摸上明胶。在探头和托架联合装置上盖上探头盖(d)。用绷带固定探头盖。
- 4 如图所示，将针导器(e)放到托架上，高位固定锁垫。
- 5 下推锁垫，直到锁钮(f)处，将针导器锁到位。
- 6 为了能快速松开针头，下压针导器垫(g)。
- 7 为了取下针导器，上拉锁垫，直到锁钮(h)处。

! 针导器为一次性器械。不可重复使用。不可再次消毒。
单次使用的器件的再利用、再加工或重新消毒可能产生交叉污染、病人感染和/或器件故障的风险。
使用后，将一次性组件按感染性废弃物处理。如果无菌包装损坏，不要使用。

STERILE EO

! 不可重复使用

对可重复使用的器械进行清洁、消毒和灭菌

清洁

重复使用的器械，在开始杀菌程序前，应彻底清洁。谨记，如果不首先清洁联合装置，根本就不可能进行杀菌或高级别消毒。

1. 冲洗掉器械上的过剩污垢。
2. 遵照制造商的正确稀释说明，调制酶溶液（如 Enzol）。
3. 将器械完全浸入洗涤剂中，浸泡 10 分钟。
4. 浸泡后，用软毛刷彻底刷洗器械。使用适当大小的毛刷清洗口径和孔。可使用注射器冲洗器械上难以触及的区域。
5. 彻底冲洗并擦干器械。切记使用 R/O（逆渗透）或 DI（去离子）水冲洗器械，自来水可能会再次污染经过再处理的器械。用干净的软布擦干器械。
6. 认真仔细地检查所有表面，确保表面没有清晰可见的微生物污染残余。若发现器械部件上有任何清晰可见的微生物污染，应重复清洁并擦干，直到整个器械完全干净。

对可重复使用的塑料或阳极氧化铝制器械进行消毒和灭菌的建议

采纳上述建议清洁后，在 pH 值为中性的 Enzol 酶消毒剂，如强生公司生产的消毒剂中浸泡至少 5 分钟。使用 Cidex 活性二醛溶液（如强生公司产品），或杀菌部门针对类似器械采用的任何已验证的等效消毒法进行消毒。

适用于可重复使用的不锈钢器械的蒸汽灭菌法

采用上述建议清洁后，使用高压蒸汽灭菌器，在温度至少达到 132 (270) 的条件下至少进行 15 分钟蒸汽消毒（重力型消毒器类）。对器械进行至少 25 分钟的干燥处理。
在高压蒸汽灭菌器的一个灭菌周期内对多台仪器进行消毒时，确保不要超过消毒器的最大载荷。

警告

- 在清洁过程中要特别注意长而窄的套管和盲孔。
- 请勿再次使用或重新处理一次性器械。
- 器械杀菌后应适当包装和储存，确保再次使用前其清洁程度不受影响。
- 必须采用探头盖，以尽量减少污染物。

检查及功能测试

目测检查有无破损和磨损。对于铰链式仪器，检查铰链运动是否顺畅，确保无过度“晃动”。应检查锁定器械机能。

再处理限制

重复处理对这些器械所产生的影响微乎其微。使用寿命终止通常是由使用产生的磨损和破损决定的。

该说明的译文，请访问 www.protekmedical.com。
如需更多信息，请联系 Protek Medical Products, Inc.。

免责声明：

上述提供的使用说明已经过医疗器械制造商验证，这些医疗器械制造商能够制造可重复使用的医疗器械。若与建议的处理方法存在任何偏差，用户有责任证明此类偏差的准确性，并正确评估有效性和潜在的不良后果。